

Bruksanvisning



FreeStyle *Libre* 2

FLASH GLUKOSÖVERVAKNINGSSYSTEM



Ditt namn _____





















Innehåll



Symboler på avläsaren	1
Viktig säkerhetsinformation	3
Indikationer för användning	3
Kontraindikationer	4
Lära känna systemet	10
Avläsarkit	11
Sensorkit	12
Datahanteringsprogram	15
Ställa in avläsaren för första gången	16
Använda sensorn	19
Applicera sensorn	20
Starta sensorn	24
Kontrollera ditt glukosvärde	25
Larm	31
Ställa in larm	34
Ställa in larmljud	38
Använda larm	39
Lägga till anteckningar	41

Granska din historik	43
Loggbok	45
Dagligt diagram	46
Andra historikalternativ.....	47
Ta bort sensorn	49
Byta ut sensorn	50
Använda påminnelser	51
Använda den inbyggda mätaren	53
Blodglukostestning.....	55
Blodketontestning.....	59
Kontrollösningstest.....	64
Använda kalkylatorn för direktverkande insulin.....	68
Ladda din avläsare	75
Ändra avläsarinställningar	76
Att leva med systemet	79
Aktiviteter.....	79
Rengöring.....	81
Underhåll	81
Kassering	82

Felsökning	83
Det går inte att slå på avläsaren	83
Problem vid sensorappliceringsstället	84
Problem med att starta sensorn eller ta emot sensoravläsningar	85
Problem med att få glukoslarm	88
Felmeddelanden för blodglukos eller ketoner	90
Problem med att kontrollera blodglukos eller keton.....	94
Utför ett avläsartest	96
Kundservice	96
Sjukvårdsalternativ	97
Ändra dossteg	98
Ställa in insulinkalkylatorn	99
Enkel inställning av insulinkalkylatorn.....	101
Avancerad inställning av insulinkalkylatorn.....	105
Ändra inställningarna för insulinkalkylatorn	116
Systemets specifikationer	117
Specifikationer för kalkylatorn för direktverkande insulin	121
Symboler på märkningen	122
Elektromagnetisk kompatibilitet	123

Symboler på avläsaren

Symbol	Betydelse
	Aktiv sensor
    	Riktning som ditt glukosvärde rör sig i. Se avsnittet <i>Kontrollera ditt glukosvärde</i> för mer information.
	Försiktigt
   	Visa föregående/nästa skärm
	Anteckningar
	Lägga till mer information till anteckningar
	Måltidsanteckning
	Anteckning om direktverkande insulin
	Avläsarens tid har ändrats
	Ljud och vibration PÅ
	Ljud PÅ , vibrationer AV
	Ljud AV , vibrationer PÅ
	Ljud och vibration AV

Symbol	Betydelse
	Sensorn kommunicerar med avläsaren
	Sensorn kommunicerar inte med avläsaren
	Blodglukos- eller ketontest
	Inställningar
	Resultat från kontrollösningstest
	Kalkylator för direktverkande insulin
	Information om din föreslagna insulindos
	Uppskattad mängd direktverkande insulin som är kvar i kroppen
	Svagt batteri
	Batteriet laddas
	Sensorn är för kall
	Sensorn är för varm

Indikationer för användning

Avläsaren till FreeStyle Libre 2 Flash glukosövervakningssystem ("Avläsare") är avsedd för mätning av glukosnivåer i den interstitiella vätskan hos patienter (4 år eller äldre) med diabetes mellitus, inklusive gravida kvinnor, vid användning tillsammans med sensorn till FreeStyle Libre 2 Flash glukosövervakningssystem ("Sensor"). Avläsaren och sensorn är utformade för att ersätta blodsockertestning vid egenvård av diabetes, inklusive dosering av insulin.

Indikationen för barn (4–12 år) är begränsad till de som övervakas av en anhörigvårdare som är över 18 år. Anhörigvårdaren ansvarar för att hantera eller hjälpa barnet att hantera avläsaren och sensorn samt för att tolka eller hjälpa barnet att tolka sensorns glukosvärden.

Kontraindikationer

Sensorn måste avlägsnas före magnetröntgenundersökningar (MR).

VARNING!

- Ignorera inte symtom som kan bero på för lågt eller högt blodglukos. Om du får symtom som inte stämmer med glukosvärdet från sensorn eller misstänker att värdet kan vara felaktigt ska du kontrollera värdet genom att göra ett fingerstickstest med en blodglukosmätare. Kontakta sjukvårdspersonal om du upplever symtom som inte stämmer med dina glukosvärden.
- FreeStyle Libre 2 Flash glukosövervakningssystem ("Systemet") innehåller smådelar som kan vara farliga om de sväljs.

Försiktighetsuppmaningar och viktig systeminformation:



Vad systemet inte har utvärderats för:

- Systemet har inte utvärderats för användning med andra implanterade medicinska enheter, t.ex. pacemakrar.
- Systemet har inte utvärderats för användning hos personer på dialysbehandling eller hos patienter under fyra år.



Hur ska sensorn förvaras?

- Förvara sensorkitet mellan 4 °C och 25 °C. Du behöver inte förvara sensorkitet i kylskåp, men du kan göra det förutsatt att kylskåpet har en temperatur mellan 4 °C och 25 °C.



När skiljer sig sensorglukos från blodglukos?

- Glukosnivåer i interstitiell vätska kan skilja sig från blodglukosnivåer och det kan innebära att sensorglukosvärdena skiljer sig från blodglukosvärdena. Du kan märka denna skillnad då din blodglukos ändras snabbt, till exempel efter att du har ätit, tagit insulin eller motionerat.



När ska jag ta bort sensorn?

- Vid sällsynta tillfällen kan du få felaktiga glukosvärden av sensorn. Om du tror att glukosvärdena inte är korrekta eller om de inte stämmer med hur du mår ska du ta ett blodglukostest i fingret för att bekräfta ditt glukosvärde. Ta bort sensorn och applicera en ny om problemet fortsätter.
- Vissa individer kan vara känsliga för materialet i häftan som håller fast sensorn på huden. Ta bort sensorn och sluta använda systemet om du noterar betydande hudirritation runt eller under sensorn. Kontakta sjukvårdspersonal innan du fortsätter att använda systemet.
- Om du har ett klinik- eller sjukhusbesök som inkluderar stark magnetisk eller elektromagnetisk strålning, t.ex. röntgen, MR eller CT ska du ta bort sensorn och sätta på en ny efter besöket. Effekterna av denna typ av undersökningar på systemets prestanda har inte utvärderats.



Vad du behöver veta om att bära sensorn:

- Återanvänd inte sensorer. Sensorn och sensorapplikatorn är avsedda för engångsbruk. Återanvändning kan leda till att du inte får några glukosavläsningar eller infektionsrisk. Ej lämplig för omsterilisering. Ytterligare strålexponering kan orsaka felaktiga resultat.



Vad du behöver veta om glukoslarm:

- För att du ska kunna få larm måste de vara **PÅ** och du måste se till att din avläsare alltid är inom 6 meter (20 fot) från dig. Överföringsområdet är 6 meter (20 fot) utan blockering. Om du är utanför området kanske du inte får några glukoslarm.
- Se till att avläsaren är tillräckligt laddad och att ljud och/eller vibrationer är på för att förhindra att du missar larm.



Vad du behöver veta om avläsarens inbyggda mätare:

- Avläsaren är avsedd att användas endast med FreeStyle Precision blodglukos- och blodketonteststickor samt MediSense kontrollösning.
- Avläsaren är avsedd att användas av endast en person. Den får inte användas på mer än en person, inklusive andra familjemedlemmar, på grund av risken för smittspridning. Alla delar i avläsaren ska anses vara smittförande och kan potentiellt överföra smittsamma sjukdomar, även efter att avläsaren rengjorts.
- Undvik att få damm, smuts, blod, kontrollösning, vatten eller andra ämnen i avläsarens USB-port och teststickans port.

Lära känna systemet

FreeStyle Libre 2 Flash glukosövervakningssystem (systemet) består av två huvuddelar: en handhållen avläsare och en engångssensor som du bär på kroppen. Du kan använda avläsaren för att trådlöst läsa av sensorn och visa dina glukosvärden. Avläsaren fungerar endast med FreeStyle Libre 2 sensorer och kan inte användas med andra sensorer. FreeStyle Libre 2 sensorn kommunicerar med avläsaren automatiskt och kan avge glukoslarm om du väljer att aktivera detta. Avläsaren har även en inbyggd mätare för blodglukos- och ketontestning.




VIKTIGT! Säkerhetsinformation om systemet finns i denna användarhandbok. Läs all information i användarhandboken och i bruksanvisningen till FreeStyle Precision blodglukos- och blodketonteststicker innan du använder systemet.

Systemet levereras i ett **avläsarkit** och ett **sensorkit**. När du öppnar dessa kit ska du kontrollera att innehållet inte är skadat och att alla delar i listan finns med. Kontakta kundservice om några delar saknas eller är skadade.

Avläsarkit

Avläsarkitet innehåller:

- FreeStyle Libre 2 avläsare
- Strömadapter
- Snabbstartguide
- USB-kabel
- Bruksanvisning
- Bilaga om prestandadata

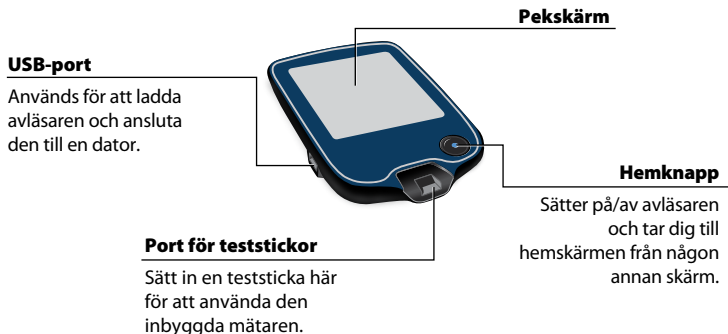

Avläsaren får glukosvärden från sensorn och kan även avge glukoslarm om detta är på. Den kan spara cirka 90 dagars glukoshistorik och anteckningar du gör om aktiviteter, t.ex. insulinintag, måltider eller motion. Denna information kan hjälpa dig att förstå hur dessa aktiviteter påverkar ditt glukosvärde.

Sensorkit

Sensorkitet innehåller:

- Sensorförpackning
- Bipacksedel
- Sensorapplikator



Sensorförpackning

Används tillsammans med sensorapplikatorn för att förbereda sensorn för användning.



Sensorapplikator

Fäster sensorn på kroppen.

Sensorn mäter och sparar glukosvärden när den bärs på kroppen. Sensorn levereras först i två delar: en del finns i sensorförpackningen och den andra i sensorapplikatorn. Följ instruktionerna för att preparera och applicera sensorn på baksidan av överarmen. Sensorn har en liten, flexibel spets som förs in strax under huden. Sensorn kan bäras i upp till 14 dagar.




Sensor

Mäter ditt glukosvärde medan den bärs på kroppen (endast synlig efter applicering).

Avläsarens hemskärm ger tillgång till information om ditt glukosvärde och om systemet. Tryck på hemknappen för att komma till hemskärmen.

Hemskärmen

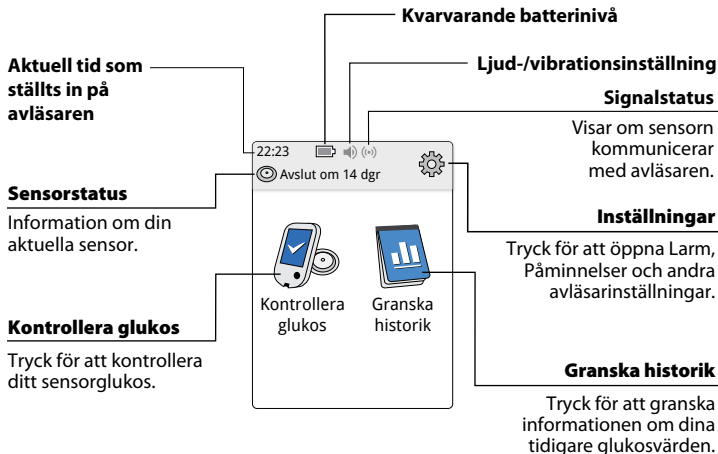

Obs! Ljud-/vibrationsinställningen och signalstatussymboler visas endast om något av larmen är på.

Sensors skärm med glukosvärden visas när du använt avläsaren till att läsa av din sensor. Din avläsning visar aktuellt glukosvärde, en glukostrendpil som indikerar åt vilket håll ditt glukosvärde är på väg och ett diagram som visar dina aktuella och sparade glukosvärden.

Sensors glukosvärden

Meddelande

Tryck för mer information.

Lägg till anteckningar

Tryck för att lägga till anteckningar om glukosvärdet.

Aktuellt glukos

Glukos från din senaste avläsning.

Glukostrendpil


Riktning som ditt glukosvärde rör sig i.

Måltid-santeckning

Anteckning om direktverkande insulin

Glukosdiagram

Diagram över dina aktuella och lagrade glukosvärden.



Datahanteringsprogram

För att ladda upp data från avläsaren, besök www.FreeStyleLibre.com och läs mer om datahanteringsprogrammet som du kan använda.

Ställa in avläsaren för första gången

Innan du använder systemet för första gången måste avläsaren ställas in.

Steg

Åtgärd

1




Tryck på hemknappen för att starta avläsaren.

2



Om du uppmanas därtill använder du pekskärmen för att välja önskat språk för avläsaren. Tryck på **OK** för att fortsätta.



Obs! Använd en fingertopp. Använd **INTE** fingernageln eller något annat föremål på skärmen.

3

Aktuellt datum

▲	▲
14	Juni 2018
▼	▼

tillbaka nästa

Ställ in **Aktuellt datum** med hjälp av pilarna på pekskärmen. Tryck på **nästa** för att fortsätta.

4

Aktuell tid

▲	▲
12	: 00
▼	▼

tillbaka nästa


Ställ in **Aktuell tid**. Tryck på **nästa** för att fortsätta.

FÖRSIKTIG: Det är mycket viktigt att ställa in tid och datum korrekt. Dessa värden påverkar avläsarens data och inställningar.

5

Avläsaren visar nu viktig information om två huvudämnen för att hjälpa dig använda systemet:

- Hur du ska förstå glukostrendpilen på skärmen med glukosvärdet.
- Hur du gör för att komma tillbaka till hemskärmen från en annan skärm.




Tryck på **nästa** för att gå vidare till nästa ämne. I slutet av inställningen av avläsaren trycker du på **klar** för att gå till hemskärmen.



Obs! Ladda avläsaren om batterinivån är låg. Använd endast USB-kabeln och strömadaptern som medföljer systemet.

FÖRSIKTIG:



- Sensorförpackningen och sensorapplikatoren är förpackade som ett set (separat från avläsaren) och har samma sensorkod. Kontrollera att sensorkoderna matchar innan du använder sensorförpackningen och sensorapplikatoren. Sensorförpackningar och sensorapplikatorer med samma sensorkod ska användas tillsammans, annars kan dina glukosvärden bli felaktiga.
- Intensiv motion kan göra att sensorn lossnar på grund av svett eller för att sensorn rört sig. Om din sensor lossnar kan du inte få några avläsningar eller opålitliga avläsningar, vilka kanske inte överensstämmer med hur du mår. Följ anvisningarna för att välja ett lämpligt applikationsställe.



Applicera sensorn

Steg	Åtgärd
1	 <p>Applicera sensorer endast på baksidan av överarmen. Undvik områden med ärr, födelsemärken, hudbristningar eller ojämnheter. Välj ett område av huden som normalt är slät under dina dagliga aktiviteter (som inte böjs eller veckas). Välj en plats som ligger minst 2,5 cm (1 tum) från ett injektionsställe för insulin. För att förhindra obehag eller hudirritation ska du välja ett annat ställe än det du använde senast.</p>
2	 <p>Tvätta appliceringsstället med vanlig tvål. Torka och rengör det sedan med en alkoholservett. Detta hjälper till att ta bort eventuella fettrester som kan förhindra att sensorn fäster ordentligt. Låt stället lufttorka innan du fortsätter.</p> <p>Obs! Området MÅSTE vara rent och torrt, annars kanske sensorn inte fäster på stället.</p>


3



Öppna sensorförpackningen genom att dra bort locket helt och hållet. Skruva loss korken från sensorapplikatorn och lägg det åt sidan.

FÖRSIKTIG: Använd INTE sensorförpackningen eller sensorapplikatorn om de verkar vara skadade eller redan är öppnade. Använd INTE produkten om utgångsdatum har passerats.

4



Placera den mörka markeringen på sensorapplikatorn mot den mörka markeringen på sensorförpackningen. Tryck ned sensorapplikatorn ordentligt, på ett hårt underlag, tills det tar stopp.

5



Lyft ut sensorapplikatorn ur sensorförpackningen.


6



Sensorapplikatorn är nu förberedd och redo för att applicera sensorn.

FÖRSIKTIG: Sensorapplikatorn innehåller nu en nål. Vidrör INTE sensorapplikatorns insida och sätt inte tillbaka den i sensorförpackningen.


7



Placera sensorapplikatorn över det förberedda stället och tryck ned den ordentligt för att applicera sensorn på kroppen.

FÖRSIKTIG: Tryck INTE nedåt på sensorapplikatorn förrän den placerats över ett förberett ställe för att förhindra oavsiktliga resultat eller skada.

8



Dra försiktigt bort sensorapplikatorn från kroppen. Sensorn ska nu vara fäst på huden.

Obs! Applicering av sensorn kan orsaka blåmärken eller blödning. Om det inte slutar blöda ska du ta bort sensorn och applicera en ny sensor på ett annat ställe.


9



Kontrollera att sensorn sitter ordentligt fast efter appliceringen.

Sätt tillbaka locket på sensorapplikatorn. Kassera den använda sensorförpackningen och sensorapplikatorn. Se avsnittet *Kassering*.

Starta sensorn

Steg	Åtgärd
1	 <p>Tryck på hemknappen för att starta avläsaren.</p>
2	 <p>Tryck på Starta ny sensor.</p>
3	 <p>Håll avläsaren inom 4 cm (1,5 tum) från sensorn för att läsa av den. Detta startar sensorn. Om ljud är på piper avläsaren när sensorn har aktiverats. Sensorn kan användas för att kontrollera ditt glukosvärde efter 60 minuter.</p> <p>Obs! Om sensorn inte har lästs av inom 15 sekunder visar avläsaren en uppmaning om att läsa av sensorn igen. Tryck på OK för att komma tillbaka till hemskrmen och tryck på Starta ny sensor för att läsa av sensorn.</p>


Kontrollera ditt glukosvärde

Steg	Åtgärd
1	 <p data-bbox="368 222 441 249">ELLER</p>  <p data-bbox="621 166 1007 298">Aktivera avläsaren genom att trycka på hemknappen eller tryck på Kontrollera glukos på hemskrmen.</p>
2	 <p data-bbox="391 401 1019 529">Håll avläsaren inom 4 cm (1,5 tum) från sensorn för att läsa av den. Sensorn skickar glukosvärden trådlöst till avläsaren. Om ljud är på piper avläsaren när sensorn har lästs av.</p> <p data-bbox="211 601 980 736">Obs! Om sensorn inte har lästs av inom 15 sekunder visar avläsaren en uppmaning om att läsa av sensorn igen. Tryck på OK för att komma tillbaka till hemskrmen och tryck på Kontrollera glukos för att läsa av sensorn.</p>

Steg


Åtgärd

3



Avläsaren visar ditt aktuella glukosvärde tillsammans med ditt glukosdiagram och en pil som anger åt vilket håll ditt glukosvärde är på väg.

Sensors glukosvärden

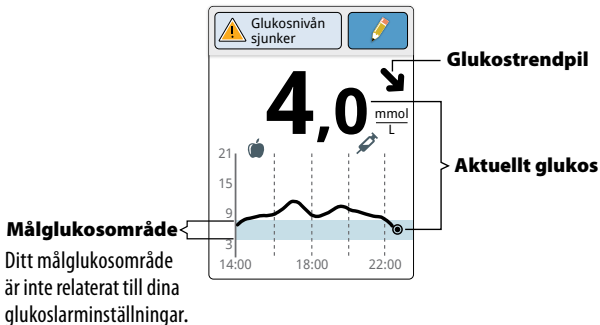

Anmärkningar:

- Diagrammet visar glukosvärden upp till 21 mmol/L. Glukosvärden över 21 mmol/L visas som 21 mmol/L.
- Symbolen ⌚ kan visas, vilket indikerar att tidsinställningen på avläsaren har ändrats. Vissa delar av diagrammet kan saknas eller glukosvärden kan vara dolda.
- Alla tillgängliga glukosdata har använts för att generera ditt diagram, så du kan förvänta dig att se vissa skillnader mellan diagramlinjerna och tidigare aktuella glukosvärden.

Glukostrendpilen ger dig en indikering om åt vilket håll ditt glukosvärde förändras.



Glukosnivån stiger snabbt
(mer än 0,1 mmol/L i minuten)



Glukosnivån stiger
(mellan 0,06 och 0,1 mmol/L i minuten)



Glukosnivån ändras sakta
(mindre än 0,06 mmol/L i minuten)




Glukosnivån sjunker
(mellan 0,06 och 0,1 mmol/L i minuten)



Glukosnivån sjunker snabbt
(mer än 0,1 mmol/L i minuten)


Nedanstående tabell visar meddelanden som du kan se tillsammans med dina glukosvärden.

Teckenfönster




Gör så här

Om **LO** visas på avläsaren är din avläsning lägre än 2,2 mmol/L. Om **HI** visas på avläsaren är din avläsning högre än 27,8 mmol/L. Du kan trycka på meddelandeknappen för mer information. Kontrollera din blodglukos på ditt finger med en teststicka. Om du får ett andra **LO**- eller **HI**-värde ska du kontakta sjukvårdspersonalen **omedelbart**.



Om ditt glukosvärde är högre än 13,3 mmol/L eller lägre än 3,9 mmol/L visas ett meddelande på skärmen. Du kan tryck på meddelandeknappen för mer information och ställa in en påminnelse att kontrollera ditt glukosvärde.

Teckenfönster



Gör så här

Om ditt glukosvärde beräknas bli högre än 13,3 mmol/L eller lägre än 3,9 mmol/L inom 15 minuter visas ett meddelande på skärmen. Du kan tryck på meddelandeknappen för mer information och ställa in en påminnelse att kontrollera ditt glukosvärde.

Anmärkningar:

- Om du är osäker på ett meddelande eller värde ska du kontakta sjukvårdspersonal innan du gör någonting.
- Meddelanden du får med dina glukosvärden är inte relaterade till dina glukoslarminställningar.

Larm

När du befinner dig inom avläsarens område kommunicerar sensorn automatiskt med avläsaren för att avge larm om lågt och högt glukosvärde, om de är **PÅ**. Dessa larm är **AV** som standard.

Detta avsnitt förklarar hur man slår på och ställer in larm, liksom hur man använder dem. Läs all information i detta avsnitt innan du ställer in och använder larm.


FÖRSIKTIG:


- För att du ska kunna få larm måste de vara **PÅ** och du måste säkerställa att din avläsare alltid är inom 6 meter (20 fot) från dig. Överföringsområdet är 6 meter (20 fot) utan blockering. Om du är utanför området kanske du inte får några glukoslarm.
- Se till att avläsaren är tillräckligt laddad och att ljud och/eller vibrationer är på för att förhindra att du missar larm.


VIKTIGT! Vad du behöver veta om glukoslarm


- Läs av din sensor ofta för att kontrollera ditt glukosvärde. Om du får ett larm om lågt eller högt glukosvärde måste du få fram ett glukosresultat för att avgöra vad du ska göra härnäst.
- Använd inte enbart larmen om lågt och högt glukosvärde för att detektera tillstånd med lågt eller högt glukosvärde. Glukoslarmen ska alltid användas tillsammans med aktuellt glukosvärde, glukostrendpil och glukosdiagram.
- Larm om lågt och högt glukosvärde skiljer sig från dina värden i målglukosområdet. Larm om lågt och högt glukosvärde talar om för dig när ditt glukosvärde har passerat den nivå du ställde in för larmet. Ditt målglukosområde visas i glukosdiagrammen på avläsaren och används för att beräkna Tid i målvärdesområdet.


VIKTIGT! Hur du förhindrar att missa larm

- För att du ska kunna få larm måste de vara **PÅ** och du måste säkerställa att din avläsare alltid är inom 6 meter (20 fot) från dig. Sensorn själv avger inga larm.
- Om sensorn inte kommunicerar med avläsaren får du inga glukoslarm och du kan missa att upptäcka händelser med lågt eller högt glukosvärde. Du ser symbolen  på hemskärmen när sensorn inte kommunicerar med avläsaren. Se till att Larmet om signalförlust är på så att du blir meddelad om din sensor inte har kommunicerat med avläsaren på 20 minuter.
- Se till att avläsarens ljud- och/eller vibrationsinställningar är på och att din avläsare är nära dig. Om några av larmen är på anger hemskärmen ljud-/vibrationsinställningen:

 Ljud och vibration **PÅ**




 Ljud **PÅ**, vibration **AV**

 Ljud **AV**, vibration **PÅ**

 Ljud och vibration **AV**

Ställa in larm

Rådfråga sjukvårdspersonalen för att bestämma dina larminställningar.

Steg	Åtgärd
1	 <p>Tryck på symbolen Inställningar på hemskrmen . Tryck på Larm.</p>
2	 <p>Tryck på Ändra larminställningar.</p>

3



Välj det larm du vill slå på och ställa in.
 Larm om lågt glukosvärde: Meddelar dig när ditt glukosvärde är under nivån du har ställt in.
 Larm om högt glukosvärde: Meddelar dig när ditt glukosvärde är över nivån du har ställt in.
 Larm om signalförlust: Meddelar dig när sensorn inte kommunicerar med avläsaren och du inte får larm om lågt eller högt glukosvärde.

Larm

Hur du ställer in

Larm om lågt glukosvärde

Larm om lågt glukosvärde är av som standard.

Tryck på reglaget för att slå på larmet. Larmnivån är initialt inställd på 3,9 mmol/L. Du kan använda pilarna för att ändra detta värde mellan 3,3 mmol/L och 5,6 mmol/L. Om larmet är på visas ett meddelande när din glukos sjunker under den nivå du har ställt in.

Tryck på **klar** för att spara.



Larm

Hur du ställer in

Larm om högt glukosvärde

Larm om högt glukosvärde är av som standard.

Tryck på reglaget för att slå på larmet. Larmnivån är till en början inställd på 13,3 mmol/L. Du kan använda pilarna för att ändra detta värde mellan 6,7 mmol/L och 22,2 mmol/L. Om larmet är på meddelas du när ditt glukosvärde stiger över den nivå du ställt in.

Tryck på **klar** för att spara.




Larm om signalförlust


Om larmet är på meddelas du när din sensor inte har kommunicerat med avläsaren på 20 minuter och du får inga larm om lågt eller högt glukosvärde.

Tryck på **klar** för att spara.

Obs! Första gången du sätter på larmet om lågt eller högt glukosvärde sätts även larmet om signalförlust på automatiskt.






4




När du är klar med inställningarna av larmen ska du trycka på **OK**. Skärmen Larminställningar visar nu dina aktuella larminställningar. Tryck på **OK** för att komma tillbaka till huvudmenyn Inställningar, eller tryck på **Ändra larminställningar** för att göra fler uppdateringar.

Ställa in larmljud

Steg	Åtgärd
1	 <p>Tryck på symbolen Inställningar på hemskärmen . Tryck på Ljud och Vibration för att ändra larmljuden.</p>
2	 <p>Tryck på den ljud- eller vibrationsinställning som du vill ändra. Obs! Dessa inställningar gäller både för larmen och för andra funktioner på avläsaren.</p> <p>Tryck på OK för att spara.</p>

Använda larm


Vad du ser



Vad det betyder

Larmet om lågt glukosvärde meddelar dig om ditt glukosvärde sjunker under den nivå du har ställt in. Larmet inkluderar inte ditt glukosvärde, så du behöver läsa av sensorn för att kontrollera glukosvärdet.

Tryck på **Avfärda larm och kontrollera glukos** eller tryck på hemknappen för att avfärda larmet och kontrollera ditt glukosvärde. Du får endast ett larm för varje händelse med lågt glukosvärde.



Larmet om högt glukosvärde meddelar dig om ditt glukosvärde stiger över den nivå du har ställt in. Larmet inkluderar inte ditt glukosvärde, så du behöver läsa av sensorn för att kontrollera glukosvärdet.

Tryck på **Avfärda larm och kontrollera glukos** eller tryck på hemknappen för att avfärda larmet och kontrollera ditt glukosvärde. Du får endast ett larm för varje händelse med högt glukosvärde.

Vad du ser



Vad det betyder

Larmet om signalförlust meddelar dig om din sensor inte har kommunicerat med avläsaren på 20 minuter och du inte får larm om lågt eller högt glukosvärde. Signalförlusten kan orsakas av att sensorn är för långt borta från avläsaren (mer än 6 meter (20 fot)) eller av någonting annat, t.ex. ett fel eller problem med din sensor eller avläsare.

Tryck på **Nej** för att avfärda larmet.

Tryck på **Ja** eller tryck på hemknappen för att avfärda larmet och läsa av sensorn.

Anmärkningar:

- Om du ignorerar ett larm kommer du att få samma larm igen om fem minuter, om tillståndet fortfarande kvarstår.
- Om du får ett larm medan avläsaren är ansluten till en dator måste du först koppla från avläsaren för att läsa av sensorn.


Lägga till anteckningar

Anteckningar kan sparas tillsammans med dina glukosvärden. Du kan lägga till en anteckning vid tiden för glukosvärdet eller inom 15 minuter efter att du fick ditt värde. Du kan spåra kost, insulin, motion och eventuella läkemedel du tar.

Steg

Åtgärd

1



På skärmen Glukosvärde lägger du till anteckningar genom att trycka på symbolen högst upp till höger på pekskärmen. Om du inte vill lägga till anteckningar kan du trycka på hemknappen för att gå tillbaka till den eller hålla in hemknappen för att stänga av avläsaren.

2

Markera kryssrutan bredvid anteckningarna som du vill lägga till. Tryck på nedåtpilen för att visa andra alternativ för anteckningar.

3




Efter att du har markerat kryssrutan för anteckningar om mat och insulin visas symbolen **+** till höger om anteckningen. Du kan tryck på den för att lägga till mer specifik information till din anteckning. Tryck sedan på **OK**.

- Anteckningar om insulin: Ange antal enheter som du har tagit.
- Anteckningar om mat: Ange gram eller portioner.

Obs! Anteckningar om mat 🍏 och direktverkande insulin 📝 visas som symboler i dina glukosdiagram och i din loggbok.

4



Tryck på **OK** för att spara dina anteckningar.

Du kan granska dina anteckningar i loggboken. Se avsnittet *Granska din historik* för mer information.

Granska din historik

Att granska och förstå din glukohistorik kan vara ett viktigt verktyg för att förbättra kontrollen över dina glukosvärden. Avläsaren sparar cirka 90 dagars information, och det finns flera sätt att granska dina tidigare glukosvärden, anteckningar och annan information.

Steg

Åtgärd

1



Tryck på hemknappen för att starta avläsaren. Tryck på hemknappen igen för att gå till hemskrmen.

2



Tryck på ikonen **Granska historik**.

3


Använd pilarna för att visa tillgängliga alternativ.



VIKTIGT! Samarbeta med sjukvårdspersonal så att du förstår din glukoshistorik.

Loggboken och Dagligt diagram visar detaljerad information, medan andra historikalternativ visar översikter med information för ett visst antal dagar.


Loggbok



Poster för varje gång du har läst av sensorn eller gjort ett blodglukos- eller ketontest. Om du lagt till anteckningar tillsammans med ett glukosvärde visas ✎ symbolen på den raden. Se avsnittet *Symboler på avläsaren* för mer information om symbolerna.

Tryck på posten för att granska den detaljerade informationen, inklusive eventuella anteckningar som du gjort. Du kan redigera (ändra) anteckningarna för den senaste loggboksposten förutsatt att din glukosavläsning har gjorts inom de senaste 15 minuterna.

Dagligt diagram




Ett diagram över sensorns glukosvärden per dag. Diagrammet visar ditt målglukosområde och symboler för anteckningar om mat eller direktverkande insulin som du har gjort.

Anmärkningar:

- Diagrammet visar glukosvärden upp till 21 mmol/L. Glukosvärden över 21 mmol/L visas som 21 mmol/L.
- Du kanske ser tomrum i diagrammet under tider då du inte har skannat sensorn minst en gång under 8 timmar.
- Symbolen 🕒 kan visas, vilket betyder att tidsinställningen på avläsaren har ändrats. Vissa delar av diagrammet kan saknas eller glukosvärden kan vara dolda.

Andra historikalternativ


Använd pilarna för att visa information om de senaste 7, 14, 30 eller 90 dagarna.



Medelvärde för glukos

Information om medelvärdet av sensorns glukosvärden. Det sammanlagda medelvärdet för den valda tiden visas ovanför diagrammet. Medelvärdet visas också för fyra olika perioder om 6 timmar under dygnet.


Avläsningar över eller under ditt målglukosområde är orange, medan avläsningar inom området är blå.



Dagliga mönster

Ett diagram som visar mönster och variabilitet i din sensorglukos under ett normalt dygn. Den tjocka svarta linjen visar medianen (mittpunkten) av dina glukosvärden. Den grå skuggningen representerar ett område (10–90 percentiler) av dina sensorvärden.

Obs! Dagliga mönster kräver minst 5 dagars glukosvärden.



Tid i målvärdesområdet

Ett diagram som visar procentandelen av tiden som sensors glukosvärden var över, under eller inom ditt målglukosvärde.



Händelser med lågt glukosvärde

Information om antalet händelser med lågt glukosvärde som har uppmätts av sensorn. En händelse med lågt glukosvärde registreras när sensors glukosvärde är lägre än 3,9 mmol/L i minst 15 minuter. Det sammanlagda antalet händelser visas ovanför diagrammet. Stapeldiagrammet visar händelser med lågt glukosvärde under fyra olika 6-timmarsperioder under dygnet.



Sensoranvändning

Information om hur ofta du läser av din sensor. Avläsaren rapporterar ett medelvärde för hur många gånger du läst av sensorn varje dag och procentandelen av möjliga sensordata som avläsaren registrerat från dina avläsningar.

Ta bort sensorn

Steg

Åtgärd

1



Dra upp kanten på häftan som fäster sensorn på din hud. Dra långsamt bort den från huden i en enda rörelse.

Obs! Kvarvarande häfta på huden kan avlägsnas med varmt tvålwater eller isoproylalkohol.

2

Kassera den använda sensorn. Se avsnittet *Kassering*. När du är redo att applicera en ny sensor ska du följa instruktionerna i avsnitten *Applicera sensorn* och *Starta sensorn*. Om du tog bort din senaste sensor innan den använts i 14 dagar blir du ombedd att bekräfta att du vill starta en ny sensor när du först läser av sensorn.

Byta ut sensorn

Din sensor slutar automatiskt att fungera efter 14 dagars användning och måste då bytas ut. Du bör också byta ut din sensor om du märker irritation eller obehag vid appliceringsstället eller om avläsaren rapporterar ett problem med den sensor som används för tillfället. Genom att vidta åtgärder i ett tidigt skede kan du förhindra att små problem blir större.

FÖRSIKTIG: Om glukosvärdena från sensorn INTE verkar stämma överens med hur du mår ska du kontrollera om sensorn har lossnat. Om sensorns spets har kommit utanpå din hud eller om sensorn har lossnat ska du ta bort sensorn och applicera en ny.


Använda påminnelser

Du kan använda påminnelser som hjälper dig att komma ihåg sådant som att kontrollera ditt glukosvärde eller ta insulin.

Steg

Åtgärd

1




Tryck på inställningssymbolen på
hemschärmen .



Rulla ned med pilen och tryck på
Påminnelser.

2



Tryck för att välja vilken **Typ** av påminnelse du
vill ställa in: Kontrollera glukos, Ta insulin eller
Övriga, vilket är en allmän påminnelse för att
hjälpa dig komma ihåg någonting.

Steg	Åtgärd
<p>3</p>	<p>Tryck för att välja hur ofta du vill att påminnelsen ska upprepas: En gång, dagligen eller timer. Obs! Du kan ställa in påminnelser vid en viss specifik tidpunkt (t.ex. kl. 08:30) eller som en timer (t.ex. tre timmar från aktuell tid).</p>
<p>4</p>	<p>Ställ in påminnelsens tid med hjälp av pilarna på pekskärmen. Tryck på spara.</p>
<p>5</p>	<p>På skärmen Påminnelser kan du ställa in påminnelse på/av eller lägga till nya påminnelser. Tryck på klar för att komma tillbaka till hemskärmen.</p>



Du kommer att få en påminnelse även om avläsaren är avstängd. Tryck på **OK** för att avfärda påminnelsen eller på **snooze** för att bli påmind igen om 15 minuter.

Obs! Påminnelser visas inte om avläsaren är ansluten till en dator.

Använda den inbyggda mätaren

Avläsaren har en inbyggd mätare som kan användas för att testa din blodglukos och blodketon, eller för att testa mätaren och stickorna med kontrollösning.

VARNING! Använd INTE den inbyggda mätaren medan avläsaren är ansluten till ett eluttag eller till en dator.

VIKTIGT!

- Använd avläsaren inom teststickans driftstemperaturområde, eftersom blodglukos- och blodketonresultat som fås utanför området kan vara mindre exakta.
- Använd endast FreeStyle Precision teststickor.
- Använd en teststicka omedelbart efter att den har tagits ut ur folieförpackningen.
- Använd bara en teststicka en gång.
- Använd inte teststickor som gått ut eftersom de kan ge felaktiga resultat.
- Använd inte en våt, böjd, repad eller skadad teststicka.
- Använd inte teststickan om folieförpackningen har ett hål eller en reva.
- Resultat från den inbyggda mätaren visas endast i din loggbok och inte i övriga historikalternativ.
- Se bruksanvisningen för din blodprovstagare för information om hur du använder blodprovstagaren.

Blodglukostestning

Du kan använda den inbyggda mätaren för att kontrollera din blodglukos, oavsett om du bär en sensor eller inte. Du kan utföra ett blodglukostest på din fingerspets eller ett godkänt alternativt ställe. Var noga med att läsa teststickans bruksanvisning innan du använder den inbyggda mätaren.

Steg

Åtgärd

1



FÖRSIKTIG: Om du tror att du har lågt glukosvärde (hypoglykemi) eller om du lider av hypoglykemi utan förkänning rekommenderar vi att du testar i fingret.


Tvätta händerna och teststället med varmt tvålatten för korrekta resultat. Torka händerna och teststället noga. Lägg på en varm, torr dyna eller gnid kraftigt i några sekunder för att värma upp stället.

Obs! Undvik områden nära ben och områden med mycket behåring. Om du har ett blåmärke, överväg att välja en annan plats.

Steg**Åtgärd****2**

t.ex.
Utgångsdatum:
den 31 mars 2021

Kontrollera teststickans utgångsdatum.

3

Öppna teststickans folieförpackning vid skåran och riv nedåt för att ta ut teststickan. Använd teststickan omedelbart efter att den har tagits ut ur folieförpackningen.

4

Sätt in teststickan med de tre svarta strecken i änden riktade uppåt. Skjut in teststickan tills det tar stopp.

5

Använd blodprovstagaren för att få fram en bloddroppe och applicera blod på det vita området i teststickans ände.

Om ljud är påslaget piper avläsaren en gång för att tala om att du har applicerat tillräckligt med blod.

Obs! Se teststickans bruksanvisning för instruktioner om omapplicering.




En fjäril visas på skärmen medan du väntar på resultatet. Om ljud är påslaget piper läsaren en gång när ditt resultat är klart.


6

Efter att du har granskat ditt resultat tar du bort och kasserar den använda teststicken enligt teststickans bruksanvisning.

VIKTIGT! Tvätta händerna och teststället med tvål och vatten efter att du har utfört ett blodglukostest. Torka dem sedan noggrant.




Dina blodglukosresultat

Blodglukosresultat markeras på resultatskärmen och i loggboken med symbolen .


Obs! Kontakta sjukvårdspersonal om du har symtom som inte överensstämmer med dina mätresultat.

Teckenfönster




Gör så här

Om **LO** visas på avläsaren är ditt resultat lägre än 1,1 mmol/L. Om **HI** visas på avläsaren är ditt resultat högre än 27,8 mmol/L. Du kan trycka på meddelandeknappen för mer information. Kontrollera din blodglukos igen med en teststicka. Om du får ett andra **LO**- eller **HI**-värde ska du kontakta sjukvårdspersonalen **omedelbart**.



Om ditt glukosvärde är högre än 13,3 mmol/L eller lägre än 3,9 mmol/L visas ett meddelande på skärmen. Du kan tryck på meddelandeknappen för mer information och ställa in en påminnelse att kontrollera ditt glukosvärde.


Efter att du fått dina blodglukosresultat kan du lägga till anteckningar genom att trycka på symbolen . Om du inte vill lägga till en anteckning kan du trycka på hemknappen för att gå tillbaka till hemskärmen eller hålla in hemknappen för att stänga av avläsaren.

Blodketontestning

Du kan använda den inbyggda mätaren för att kontrollera ditt blodketonvärde (β -hydroxybutyrat). Det är viktigt att överväga att göra detta när:

- Du är sjuk
- Ditt glukosvärde är högre än 13,3 mmol/L
- Du och sjukvårdspersonalen bestämmer att du borde

Obs! Se till att läsa teststickans bruksanvisning innan du gör ett ketontest.


Steg	Åtgärd
1	 <p>Tvätta dina händer med varmt tvålatten för korrekta resultat. Torka händerna noga. Lägg på en varm, torr dyna eller gnid kraftigt i några sekunder för att värma upp stället.</p> <p>Obs! Använd endast prover från fingertoppen för blodketontestning.</p>

Steg**Åtgärd****2**


Kontrollera teststickans utgångsdatum.

t.ex.

Utgångsdatum:
den 31 mars 2021

3

Öppna teststickans folieförpackning vid skåran och riv nedåt för att ta ut teststickan. Använd teststickan omedelbart efter att den har tagits ut ur folieförpackningen.

4

Obs! Använd endast blodketonteststickor. Placera inte urin på teststickan.

Sätt in teststickan med de tre svarta strecken riktade uppåt. Skjut in teststickan tills det tar stopp.

5



Använd blodprovstagaren för att få fram en bloddroppe och applicera blod på det vita området i teststickans ände.

Om ljud är påslaget piper avläsaren en gång för att tala om att du har applicerat tillräckligt med blod.

Obs! Se teststickans bruksanvisning för instruktioner om oapplicering.




En fjärl visas på skärmen medan du väntar på resultatet. Om ljud är påslaget piper avläsaren en gång när ditt resultat är klart.

6

Efter att du har granskat ditt resultat tar du bort och kasserar den använda teststickan enligt teststickans bruksanvisning.

VIKTIGT! Efter att du har utfört ett blodketontest ska du tvätta händerna med tvål och vatten. Torka sedan noggrant.




Dina blodketonresultat

Blodketonresultat markeras på resultatskärmen och i loggboken med ordet **keton**.

Anmärkningar:


- Blodketonvärdet förväntas vara lägre än 0,6 mmol/L.
- Blodketon kan vara högre om du är sjuk, fastar, har motionerat mycket eller om glukosnivåerna inte är kontrollerade.
- Om ditt blodketonresultat förblir högt eller om det blir högre än 1,5 mmol/L ska du kontakta sjukvårdspersonalen **omedelbart**.

Teckenfönster



Gör så här

Om ditt blodketonvärde är högt visas ett meddelande på skärmen. Du kan trycka på meddelandeknappen för mer information.



Om **HI** visas på avläsaren är ditt ketonresultat högre än 8 mmol/L. Du kan trycka på meddelandeknappen för mer information. Gör om ketontestet med en ny teststicka. Om du får ett andra **HI**-resultat ska du kontakta sjukvårdspersonalen **omedelbart**.


Kontrollösningstest


Du bör göra ett kontrollösningstest när du inte är säker på dina resultat från teststickan och vill kontrollera att avläsaren och teststickorna fungerar korrekt. Du kan göra ett kontrollösningstest med en blodglukos- eller ketonteststicka.

VIKTIGT!

- Kontrollösningens resultat ska ligga inom det kontrollösningsområde som är angivet i teststickans bruksanvisning.
- Kontrollösningen får INTE användas efter utgångsdatumet. Kassera kontrollösningen tre månader efter öppnande. Se kontrollösningens bruksanvisning.
- Området för kontrollösningar är ett målområde för enbart kontrollösningen, inte för dina blodglukos- eller blodketonresultat.
- Kontrollösningens resultatet återger inte din blodglukos- eller ketonnivå.
- Använd endast MediSense glukos- och ketonkontrollösning.
- Kontrollera att lotnumret som är tryckt på teststickans folieförpackning och bruksanvisningen stämmer överens.
- Sätt tillbaka locket ordentligt på flaskan omedelbart efter användning.
- Tillsätt INTE vatten eller någon annan vätska till kontrollösningen.
- Kontakta kundservice för information om hur kontrollösning kan beställas.

1



Tryck på inställningssymbolen  på hemskärmen. Rulla ned med pilen och tryck på **Kontrollösningstest**.

2




Kontrollera teststickans utgångsdatum.

t.ex.

Utgångsdatum:
den 31 mars 2021

3



Öppna teststickans folieförpackning vid skåran och riv nedåt för att ta ut teststickan.

4



Sätt in teststickan med de tre svarta strecken riktade uppåt. Skjut in teststickan tills det tar stopp.

5




Skaka kontrollösningensflaskan för att blanda lösningen. Applicera en kontrollösningensdroppe på det vita området på teststickans ände.

Om ljud är påslaget piper avläsaren en gång för att tala om att du har applicerat tillräckligt med kontrollösning.



En fjäril visas på skärmen medan du väntar på resultatet. Om ljud är påslaget piper avläsaren en gång när resultatet är klart.




**Blodglukos
Kontrollösningstest**

Kontrollösningresultat

Jämför kontrollösningresultatet med det område som står angivet i teststickans bruksanvisning. Resultatet på skärmen bör ligga inom detta område.

Kontrollösningresultatet markeras på resultatskärmen och i loggboken med symbolen .



Kontrollösningstest för keton

Obs! Gör om kontrollösningstestet om kontrollösningens resultat är utanför det område som står angivet i teststickans bruksanvisning. Sluta använda den inbyggda mätaren om kontrollösningens resultat kontinuerligt ligger utanför det angivna området. Kontakta kundservice.

Använda kalkylatorn för direktverkande insulin


Denna valfria funktion kräver en förståelse för hur insulin används. Felaktig användning eller missuppfattning av denna funktion och den föreslagna dosen kan leda till olämplig insulindosering. Kalkylatorn föreslår doser endast för direktverkande insulin. Kalkylatorn är endast avsedd för användning med blodglukosresultat via fingerstick från den inbyggda mätaren. Du kan inte använda insulinkalkylatorn med sensors glukosvärden.

En åtkomstkod krävs för att ställa in eller ändra inställningarna för kalkylatorn för direktverkande insulin. Åtkomstkoden är tillgänglig endast för sjukvårdspersonal. Samarbeta med sjukvårdspersonalen för att ställa in eller ändra kalkylatorn för dig.

Om du inte är säker på kalkylatorns föreslagna dos kan du justera den enligt instruktioner från sjukvårdspersonalen.

FÖRSIKTIG: Kalkylatorn för direktverkande insulin kan inte räkna med alla faktorer som kan påverka din insulindos. Dessa inkluderar felaktigt inmatade data, felaktigt inställt datum eller tid, ej loggat insulin, mindre eller större måltider, sjukdom, motion, etc. Det är viktigt att du går igenom din föreslagna dos och räknar med dessa faktorer innan du tar insulin.

Om du har lagt till en anteckning om direktverkande insulin till ett glukosresultat utan att ange hur mycket insulin du tog kommer inte kalkylatorn att vara tillgänglig på upp till åtta timmar.

Steg	Åtgärd
1	 <p>Kontrollera din blodglukos på fingret. Tryck på Insulinkalkylator på skärmen Blodglukosresultat. Du kan även öppna insulinkalkylatorn genom att trycka på kalkylatorikonen bredvid direktverkande insulin på skärmen Lägg till anteckningar.</p>

2

Har du glömt att logga något direktverkande insulin som du har tagit sedan X:XX?

nej

Ange direktverkande insulin som du har glömt att logga.

2 enheter

↑

↓

tillbaka

Hur länge sedan togs den ologgade dosen direktverkande insulin?

↑

↓

15 min. eller mindre

tillbaka nästa

Skriv in information om allt direktverkande insulin du kan ha glömt att logga. Tryck på **nästa**.

Anmärkningar:

- Du kan öppna kalkylatorn i upp till 15 minuter efter att du testat din blodglukos. Om avläsaren stängts av eller om du har navigerat bort från resultatskärmen kan du gå till loggboken och tryck på **lägg till eller redigera anteckningar** för att öppna kalkylatorn från din senaste blodglukospost.
- Om ditt blodglukosresultat är under 3,3 mmol/L är kalkylatorn inte tillgänglig.
- Använd inte kontrollösning för att uppnå en föreslagen dos.

3

Frukost
 Lunch
 Middag
 Ingen måltid

tillbaka nästa

Om kalkylatorn programmerats med inställningen **Enkel** trycker du på måltiden du planerar att äta nu. Tryck på **nästa**.

eller

Ange kolhydr. ?

+
- 20
gram

tillbaka klar

Om kalkylatorn programmerades med inställningen **Avancerad** anger du mängden kolhydrater i gram eller portioner som du planerar att äta nu. Tryck på **klar**.

eller

Ange portioner ?

+
- 2,0
portioner
= 30g kolhydr.

tillbaka klar

4


Föreslagen dos 


Justera vid behov

 **12E** 


Användarändr.: +2,0

tillbaka **logga dos**

Granska din föreslagna dos. Använd vid behov pilknapparna för att ändra din föreslagna dos för eventuell planerad aktivitet, en mindre eller större måltid, sjukdom etc. Tryck på symbolen  för att se detaljer om vad som inkluderas i din föreslagna dos.

Dosedetaljer 

Till frukost	9
Till 7,9 mmol/L	+2
Aktivt insulin	-1
Användarändr.	+2
Totalt	12E

 1 / 2

Insulin för att täcka din måltid

Insulin för att korrigera din aktuella glukosnivå

Insulin som är kvar i din kropp

En ändring du har gjort av den föreslagna insulindosen


Din **totala** föreslagna dos

5

Tryck på **logga dos** för att spara dosen i din loggbok och ta din dos. Dosen sparas endast i loggboken om du trycker på **logga dos**.

FÖRSIKTIG: Det är viktigt att du loggar alla dina doser av direktverkande insulin så att din avläsare kan ta med aktivt insulin när den beräknar dina föreslagna doser. Om du inte loggar alla dina doser av direktverkande insulin kan detta resultera i en föreslagen dos som är för hög.

Obs! Den totala dosen rundas upp eller ned till närmaste heltal såvida inte sjukvårdspersonal har ändrat din avläsare till att räkna med halva enhetssteg.



Om sjukvårdspersonal har aktiverat funktionen Aktivt insulin kan symbolen 🍪 visas på hemskärmen. Den visar en uppskattning av mängden direktverkande insulin som är kvar i kroppen och hur länge till det kan vara aktivt. Tryck på symbolen 🍪 för att se mer information om återstående direktverkande insulin från dina loggade doser.

Uppskattad procentandel av aktivt insulin som är kvar i din kropp



100–87 %



86–62 %



61–37 %



36–12 %



11–1 %

Ingen symbol

0 %

Ladda din avläsare

Ett fulladdat batteri i avläsaren ska hålla i upp till fyra dagar. Batteriets livslängd kan variera beroende på din användning. Ett meddelande om **Svagt batteri** visas med ditt resultat när det återstår ungefär en dags användning av batterinivån.




Laddar

Anslut den medföljande USB-kabeln till ett eluttag med den medföljande strömadaptern. Sätt sedan in USB-kabelns andra ände i USB-porten på avläsaren.

FÖRSIKTIG: Se till att välja en laddningsplats som tillåter att strömadaptern är lätt att koppla från.

Anmärkningar:

- Du måste ladda avläsaren när batteriet är svagt  för att kunna fortsätta använda avläsaren.
- Ladda avläsaren i minst tre timmar för ett fulladdat batteri.
- Använd endast den USB-kabel och strömadapter som medföljer systemet.
- Ladda din avläsare helt innan den ska förvaras i mer än tre månader.

Ändra avläsarinställningar

Du kan gå till menyn Inställningar för att ändra många inställningar på avläsaren, t.ex. larminställningar, ljud och vibration, tid och datum och rapportinställningar. Från menyn Inställningar gör du även kontrollösningstest eller kontrollerar systemstatus.

Steg

1



För att gå till menyn Inställningar trycker du på inställningssymbolen  på hemskärmen.

Åtgärd

2

Tryck på inställningen som du vill ändra:

Larm – Se avsnittet *Larm* för information om hur du ställer in larm

Ljud och vibration – Ställ in ljud och vibration på avläsaren.
Detta gäller även för larm

Tid och datum – Ändra tid eller datum

Påminnelser – Se avsnittet *Använda påminnelser* för information om hur du ställer in påminnelser

Kontrollösningstest – Utföra ett kontrollösningstest

Språk – Ändra språket på avläsaren (detta alternativ är endast tillgängligt på avläsare med flera språk)

Systemstatus – Kontrollera avläsarens information och prestanda

- Visa systeminformation: Avläsaren visar information om ditt system, vilket inkluderar:
 - Slutdatum och -tid för aktuell sensor
 - Avläsarens serienummer och versionsnummer
 - Serienummer och statuskoder till de senaste sensorerna (upp till tre)
 - Sensorversion för den senaste sensorn
 - Antal sensorer som har använts med avläsaren
 - Antal tester som har utförts med teststickor

2
(forts.)

- Visa Händelseloggar: En lista över händelser som registrerats av avläsaren, som kundservice kan ta hjälp av för att felsöka ditt system
- Utför ett avläsartest: Avläsartestet utför intern diagnostik och gör att du kan kontrollera att teckenfönstret visar alla pixlar, att ljud och vibration fungerar och att pekskärmen svarar när du trycker på den

Rapportinställningar – Samarbeta med sjukvårdspersonalen för att ställa in ditt målglukosområde, som visas i glukosdiagrammet på avläsaren och används för att beräkna din tid inom målvärdesområdet. Ditt målglukosområde är inte relaterat till dina larminställningar

Kalkylatorinställningar – Granska de aktuella programmerade inställningarna (detta alternativ är endast tillgängligt om sjukvårdspersonalen har aktiverat insulinkalkylatorn)

Grunder avläsare – Granska informationsskärmarna under inställningen av avläsaren

Sjukvårdsalternativ – Ställs endast in av sjukvårdspersonal

Att leva med systemet

Aktiviteter


Systemet kan användas under ett stort antal aktiviteter.

Aktivitet	Vad du behöver veta
Bada, duscha och simma	<p>Avläsaren är inte vattenbeständig och ska ALDRIG sänkas ned i vatten eller annan vätska.</p> <p>Sensorn är vattenbeständig och kan bäras när du badar, duschar eller simmar.</p> <p>Obs! Sänk INTE ned sensorn i vatten som är djupare än 1 meter (3 fot) eller i mer än 30 minuter.</p>
Sova	<p>Din sensor bör inte störa din sömn. Vi rekommenderar att du läser av din sensor innan du somnar och när du vaknar eftersom din sensor innehåller 8 timmars data vid ett tillfälle.</p> <p>Om du vill få larm eller påminnelser medan du sover ska avläsaren placeras i närheten. Du bör även se till att ljud och/eller vibrationer är på.</p>

Flygresor

Du kan använda systemet på ett flygplan, efter begäran från flygbesättningen.

- Vissa helkroppsskannrar på flygplatser inkluderar röntgen- eller millimetervågor som du inte kan exponera din sensor för. Effekten av dessa skannrar har inte utvärderats och exponeringen kan skada sensorn eller orsaka felaktiga resultat. För att undvika att ta bort sensorn kan du begära en annan typ av kontroll. Om du väljer att gå igenom en helkroppsskanner måste du ta bort sensorn.
- Sensorn kan exponeras för vanliga elektrostatiska (ESD) och elektromagnetiska störningar (EMI), inklusive metalldetektorer på flygplatser. Du kan ha på din avläsare medan du går genom dessa.

Obs! Om du ändrar tidszon kan du ändra inställningarna för tid och datum på avläsaren genom att trycka på inställningssymbolen  på hemskärmen, och sedan på **Tid och datum**. Ändring av tid och datum påverkar diagram och statistik.

Aktivitet	Vad du behöver veta
Flygresor (forts.)	Symbolen 🕒 kan visas på ditt glukosdiagram, vilket betyder att avläsarens tid har ändrats. Vissa delar av diagrammet kan saknas eller glukosvärden kan vara dolda.

Rengöring

Du kan rengöra avläsaren så ofta du vill med en trasa fuktad med en blandning av 1 del klorin och 9 delar vatten. Torka försiktigt av ytan på avläsaren och låt den lufttorka. Sprickbildning, flagnig eller skada på avläsarens hölje är tecken på försämring. Om du upptäcker något av dessa tecken ska du sluta använda avläsaren och kontakta kundservice.

FÖRSIKTIG: Placera INTE avläsaren i vatten eller i andra vätskor. Undvik att damm, smuts, blod, kontrollösning, vatten eller något annat ämne i kommer in i teststickans port eller i USB-portarna.

Underhåll

Det är inte möjligt att utföra service på någon av systemets delar.

Kassering

Avläsaren, sensorn, USB-kabeln och strömadaptern:

Dessa enheter får inte kasseras via kommunal (hushålls) avfallsinsamling. De kräver separat insamling för elektriskt och elektroniskt avfall enligt direktiv 2012/19/EG inom Europeiska unionen. Kontakta tillverkaren för mer information. Eftersom avläsare och sensorer kan ha exponerats för kroppsvätskor ska de rengöras före kassering med en trasa fuktad med en blandning av en del klorin med nio delar vatten.

Obs! Avläsare och sensorer innehåller icke löstagbara batterier och får inte brännas. Batterier kan explodera vid förbränning.

Sensorapplikatorn:

kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för instruktioner om hur du ska kassera sensorapplikatorn i en särskild behållare för skärande och stickande avfall. Se till att locket är på sensorapplikatorn eftersom den innehåller en nål.

Sensorförpackning:

Använda sensorförpackningar kan kasseras via kommunal (hushålls) avfallshantering.

Felsökning

Detta avsnitt innehåller problem eller observationer som du kan ha, möjlig(a) orsak(er) och rekommenderade åtgärder. Om ett fel inträffar på avläsaren visas ett meddelande på skärmen med anvisningar om hur du löser felet.

Det går inte att slå på avläsaren

Problem	Vad det kan betyda	Gör så här
Avläsaren slås inte på efter att du tryckt på hemknappen eller satt in en teststicka.	Avläsarens batteri är för svagt.	Ladda avläsaren.
	Avläsaren är utanför sitt driftstemperaturområde.	Flytta avläsaren till en temperatur mellan 10 °C och 45 °C och försök sedan slå på den igen.

Om avläsaren fortfarande inte startar efter att du provat de här åtgärderna, kontakta kundservice.

Problem vid sensorappliceringsstället

Problem	Vad det kan betyda	Gör så här
Sensorn fäster inte på huden.	Det finns smuts, olja, hår eller svett på appliceringsstället.	<ol style="list-style-type: none">1. Ta bort sensorn.2. Rengör stället med vanlig tvål och vatten och överväg att raka det.3. Följ anvisningarna i avsnitten <i>Applicera sensorn</i> och <i>Starta sensorn</i>.
Hudirritation där sensorn är placerad.	Sömmar eller andra trånga kläder eller tillbehör som orsakar friktion vid appliceringsstället.	Kontrollera att inget skaver mot appliceringsstället.
	Du kan vara känslig för det självhäftande materialet.	Om irriterationen uppstår där häftan fäster vid huden ska du kontakta sjukvårdspersonal för att hitta den bästa lösningen.

Problem med att starta sensorn eller ta emot sensoravläsningar

Teckenfönster	Vad det kan betyda	Gör så här
Ny sensor startar	Sensorn är inte redo att läsa av glukosvärdet.	Vänta tills sensorns startperiod på 60 minuter har slutförts.
Tidsgräns för avläsn.	Avläsaren hålls inte tillräckligt nära sensorn.	Håll avläsaren inom 4 cm (1,5 tum) från sensorn. För avläsarens skärm nära sensorn.
Sensor avslutad	Sensorns användningstid är slut.	Applicera och starta en ny sensor.
Larm om signalförlust	Sensorn har inte kommunicerat automatiskt med avläsaren under de senaste 20 minuterna.	Se till att avläsaren är inom 6 meter (20 fot) från sensorn. Försök läsa av sensorn för att få ett glukosvärde. Om larmet om signalförlust visas igen efter att du har läst av sensorn ska du kontakta kundservice.

Teckenfönster	Vad det kan betyda	Gör så här
Ny sensor hittad	Du skannade en ny sensor innan den tidigare sensorn tog slut.	Din avläsare kan endast användas med en sensor åt gången. Om du startar en ny sensor kan du inte längre läsa av din gamla sensor. Välj "Ja" om du vill börja använda den nya sensorn.
Avläsningsfel	Avläsaren kunde inte kommunicera med sensorn.	Försök läsa av igen. Obs! Du kan behöva flytta dig bort från potentiella källor till elektromagnetisk störning.
Sensorfel	Systemet kunde inte ge ett glukosvärde.	Läs av igen efter 10 minuter.

Teckenfönster	Vad det kan betyda	Gör så här
Glukosvärdet ej tillgängliga	Din sensor är för varm eller för kall.	Förflytta dig till en plats med lämplig temperatur och läs av igen efter några minuter.
Sensorn används redan	Sensorn startades av en annan enhet.	Din avläsare kan endast användas med en sensor som den har startat. Läs av sensorn igen med den enhet som startade den. Eller applicera och starta en ny sensor.
Kontrollera sensorn	Sensors spets kanske inte är under huden.	Försök att starta sensorn igen. Om avläsaren visar "Kontrollera sensor" igen har din sensor inte applicerats på korrekt sätt. Applicera och starta en ny sensor.
Byt sensor	Systemet har upptäckt ett problem med din sensor.	Applicera och starta en ny sensor.

Problem med att få glukoslarm

Problem	Vad det kan betyda	Gör så här
Du får inga glukoslarm.	Du har inte aktiverat larmen.	Tryck på inställningssymbolen  och välj sedan Larm .
	Sensorn kommunicerar inte med din avläsare. eller Det kan finnas ett problem med din sensor eller avläsare.	Sensorn måste vara inom ett område (6 meter (20 fot)) från avläsaren för att du ska få larm. Se till att du håller dig inom detta område. Du ser symbolen  överst på hemskärmen när din sensor inte kommunicerar med avläsaren. Om larm om signalförlust är på meddelas du att det inte funnits kommunikation under 20 minuter. Försök att läsa av sensorn. Om larmet om signalförlust är på och visas igen efter att du har läst av din sensor ska du kontakta kundservice.
	Ljud/vibrationer är avstängda.	Kontrollera avläsarens ljud- och vibrationsinställningar för att bekräfta att ljud/vibrationer är på.

Problem	Vad det kan betyda	Gör så här
Du får inga glukoslarm. (forts.)	Du kan ha ställt in en larmnivå som är högre eller lägre än du avsåg.	Bekräfta att larminställningarna är lämpliga.
	Du har redan avfärdat denna typ av larm.	Du får ett annat larm när en ny episod med lågt eller högt glukosvärde börjar.
	Din sensor har gått ut.	Byt ut din sensor mot en ny.
	Avläsarens batteri är slut.	Ladda avläsaren med den medföljande USB-kabeln.

Felmeddelanden för blodglukos eller ketoner

Felmeddelande	Vad det kan betyda	Gör så här
E-1	Temperaturen är för hög eller för låg för att avläsaren ska fungera korrekt.	<ol style="list-style-type: none">1. Flytta avläsaren och teststickorna till en plats där temperaturen är inom teststickans driftsområde. (Se teststickans bruksanvisning för lämpligt område.)2. Vänta tills avläsaren och teststickorna anpassat sig till den nya temperaturen.3. Gör om testet med en ny teststicka.4. Kontakta kundservice om felet visas igen.
E-2	Avläsarfel.	<ol style="list-style-type: none">1. Stäng av avläsaren.2. Gör om testet med en ny teststicka.3. Kontakta kundservice om felet visas igen.

Felmeddelande	Vad det kan betyda	Gör så här
E-3	Bloddroppen är för liten. eller Felaktig testprocedur. eller Det kan vara fel på teststickan.	<ol style="list-style-type: none">1. Granska testinstruktionerna.2. Gör om testet med en ny teststicka.3. Kontakta kundservice om felet visas igen.
E-4	Blodglukosnivån kan vara för hög för att avläsas av systemet. eller Det kan vara fel på teststickan.	<ol style="list-style-type: none">1. Gör om testet med en ny teststicka.2. Kontakta omedelbart sjukvårdspersonalen om felet kommer tillbaka.

Felmeddelande	Vad det kan betyda	Gör så här
E-5	Blod applicerades för snabbt på teststicken.	<ol style="list-style-type: none">1. Granska testinstruktionerna.2. Gör om testet med en ny teststicka.3. Kontakta kundservice om felet visas igen.
E-6	Teststicken kanske inte är kompatibel med avläsaren.	<ol style="list-style-type: none">1. Kontrollera att du använder rätt teststicka för den här avläsaren. (Se teststickans bruksanvisning för att verifiera att din sticka är kompatibel med den här avläsaren.)2. Gör om testet med en teststicka som ska användas med din avläsare.3. Kontakta kundservice om felet visas igen.

Felmeddelande	Vad det kan betyda	Gör så här
E-7	Teststicken kan vara skadad, använd eller känns inte igen av avläsaren.	<ol style="list-style-type: none">1. Kontrollera att du använder rätt teststicka för den här avläsaren. (Se teststickans bruksanvisning för att verifiera att din sticka är kompatibel med den här avläsaren.)2. Gör om testet med en teststicka som ska användas med din avläsare.3. Kontakta kundservice om felet visas igen.
E-9	Avläsarfel.	<ol style="list-style-type: none">1. Stäng av avläsaren.2. Gör om testet med en ny teststicka.3. Kontakta kundservice om felet visas igen.

Problem med att kontrollera blodglukos eller keton

Problem	Vad det kan betyda	Gör så här
Avläsaren startar inte ett test efter att teststickan förts in.	Teststickan är inte korrekt eller inte helt införd i teststickans port.	<ol style="list-style-type: none">1. Sätt in teststickan i testporten tills det tar stopp, med de tre svarta strecken riktade uppåt.2. Kontakta kundservice om avläsaren fortfarande inte startar testet.
	Avläsarens batteri är för svagt.	Ladda avläsaren.
	Teststickan är skadad, använd eller känns inte igen av avläsaren.	För in en ny FreeStyle Precision teststicka.
	Avläsaren är utanför sitt driftstemperaturområde.	Flytta avläsaren till en temperatur mellan 10 °C och 45 °C och försök sedan slå på den igen.
	Avläsaren är i strömsparläge.	Tryck på hemknappen och sätt sedan in en teststicka.

Problem	Vad det kan betyda	Gör så här
<p>Testet startar inte efter applicering av blodprovet.</p>	<p>Blodprovet är för litet.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se teststickans bruksanvisning för instruktioner om ny applicering. 2. Gör om testet med en ny teststicka. 3. Kontakta kundservice om testet fortfarande inte startar.
	<p>Provet applicerades efter att avläsaren stängts av.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Granska testinstruktionerna. 2. Gör om testet med en ny teststicka. 3. Kontakta kundservice om testet fortfarande inte startar.
	<p>Problem med avläsaren eller teststickan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gör om testet med en ny teststicka. 2. Kontakta kundservice om testet fortfarande inte startar.

Utför ett avläsartest



Om du tror att avläsaren inte fungerar ordentligt kan du kontrollera avläsaren genom att utföra ett avläsartest. Tryck på inställningssymbolen ⚙️ på hemskrmen, välj **Systemstatus** och sedan **Avläsartest**.

Obs! Avläsartestet utför intern diagnostik och gör det möjligt för dig att kontrollera att teckenfönstret, ljud och pekskärm fungerar korrekt.

Kundservice

Kundservice finns tillgänglig för att svara på alla frågor du har om ditt system. Telefonnummer till din kundservice finns på det bakre omslaget till denna bruksanvisning.

Rapportering av allvarliga incidenter


Om en allvarlig incident har inträffat i samband med denna enhet ska detta rapporteras till kundservice. I EU:s medlemsstater ska allvarliga incidenter också rapporteras till behörig tillsynsmyndighet (den myndighet som ansvarar för medicintekniska enheter) i ditt land. Se din regerings hemsida för mer information om hur du kontaktar din tillsynsmyndighet.


En "allvarlig incident" betyder varje incident som direkt eller indirekt har, kunde ha lett eller kan leda till:

- dödsfall för en patient, användare eller annan person,
- tillfällig eller permanent allvarlig försämring av patientens, användarens eller någon annan persons hälsotillstånd.

Sjukvårdsalternativ

Detta avsnitt är endast avsett för sjukvårdspersonal. Det beskriver funktioner på avläsaren som skyddas med åtkomstkod. Sjukvårdspersonalen kan ändra dossteg eller ställa in insulinkalkylatorn.




Tryck på inställningssymbolen  på hemskrmen. Rulla ned med pilarna och tryck på **Sjukvårdsalternativ** Skriv in åtkomstkoden.

Obs! Om du är sjukvårdspersonal ska du kontakta kundservice för mer information.

Ändra dossteg

Du kan ställa in dossteg för insulin på antingen 1,0E eller 0,5E för användning med kalkylatorn för direktverkande insulin och insulinanteckningar.



På skärmen **Sjukvårdsalternativ** väljer du **Dossteg**. Välj sedan **1** enhet eller **0,5** enhet. Tryck på **klar**.

Ställa in insulinkalkylatorn

Insulinkalkylatorn kan hjälpa dina patienter att beräkna sina doser av direktverkande insulin baserat på måltidsinformation och blodglukosnivå från fingerstick. På skärmen **Sjukvårdsalternativ** väljer du **Insulinkalkylator**.

FÖRSIKTIG: Denna funktion kräver att du förstår hur man använder insulin. Felaktig användning eller missuppfattning av denna funktion och den föreslagna dosen kan leda till olämplig insulindosering. Kalkylatorn föreslår doser endast för direktverkande insulin.

Slutför installationen för att spara din patients individuella insulininställningar i avläsaren. Kalkylatorn använder blodglukosresultat från fingerstick, måltidsinformation och sparade inställningar för att beräkna en föreslagen insulindos baserat på följande formel:

Korrigerig av
blodglukos
(om nödvändigt)

+

Måltid |
Kolhydratintag


-

Aktivt insulin
(om sådant finns)

=

Total
föreslagen
dos

Du kan ställa in insulinkalkylatorn med hjälp av inställningarna Enkel eller Avancerad. Enkel inställning är till för patienter som startar med en fast dos av direktverkande insulin för måltider. Avancerad inställning är till för patienter som räknar kolhydrater (i gram eller portioner) för att justera sin dos av direktverkande insulin för måltider.

Du måste slutföra samtliga steg i inställningen av insulinkalkylatorn för att patienten ska kunna använda kalkylatorn. När du har avslutat inställningen av insulinkalkylatorn kan du granska inställningarna för att säkerställa att de är korrekta för din patient. Du kan även granska inställningarna vid ett senare tillfälle. Tryck på inställningssymbolen  på Hemskrämen och välj sedan **Kalkylatorinställningar**.

VIKTIGT! Om tiden på avläsaren är fel, kan detta leda till en felaktig föreslagen dos.

Sjukvårdsalternativ

Enkel inställning av insulinkalkylatorn

Steg

Åtgärd

1

Välj inställningsalternativ

Enkel

För patienter som börjar med en fast dos av direktverkande insulin vid måltider.

tillbaka nästa

Välj alternativet **Enkel** med reglaget och tryck på **nästa**.

Obs! Du behöver veta din patients insulindoser vid måltid, målglukosområde, och korrigeringsfaktor.

2

Frukost

4

enheter insulin

tillbaka nästa

Skriv in dos av direktverkande insulin för varje måltid. Tryck på **nästa** efter varje post.

3

Korrigeringsmålvärde


3,9 till 7,2 $\frac{\text{mmol}}{\text{L}}$

tillbaka nästa

Skriv in **Korrigeringsmålvärde** för blodglukos. Detta är det önskade målområdet för blodglukosvärden före måltider. Tryck på **nästa**.

Obs! Om du vill ställa in ett mål istället för ett område ställer du in både de låga och höga värdena på samma värde.

4



Ange **Korrigeringsfaktor** (till exempel: om 1 E insulin sänker blodglukos med 2,8 mmol/L blir korrigeringsfaktorn 2,8). Om blodglukosvärdet ligger utanför blodglukosmålet använder kalkylatorn korrigeringsmålvärdet och -faktorn för att beräkna en korrigeringsdos.

Anmärkningar:

- Om patienten inte använder insulinkorrigerering trycker du på nedåtpilen för att gå nedanför 1 och ställa in "Ingen insulinkorrigerering". Om du ställer in "Ingen insulinkorrigerering" beräknar kalkylatorn endast måltidsdoser. Aktivt insulin spåras eller beräknas inte heller.
- Kalkylatorn korrigerar ett blodglukosvärde till ett enstaka mål eller medelvärde av målområdet.
- Kalkylatorn föreslår inte en dos som beräknas få blodglukosen att sjunka under den lägre delen av målområdet eller enstaka mål.

Tryck på **nästa**. Tryck sedan på **klar** för att slutföra inställningen. Du kan nu granska kalkylatorinställningarna. Tryck på **OK** när du är klar.

Kommentarerom alternativet Enkel:

- Kalkylatorn uppskattar mängden direktverkande insulin som finns kvar i kroppen och hur mycket längre det kommer att vara aktivt (om korrigeringsfaktorn är inställd på "Ingen insulinkorrigering" beräknas inte aktivt insulin). Uppskattning av aktivt insulin baseras på fyra timmars insulinduration, beräknat från tiden och mängden av den senaste loggade dosen direktverkande insulin.
- Både måltids- och korrigeringsdoser inkluderas i spårningen av aktivt insulin.
- Insulindoser som beräknas 0–2 timmar efter en tidigare loggad dos inkluderar endast en måltidsdos. Aktivt insulin räknas inte bort från måltids- eller kolhydratdosen, och en korrigeringsdos inkluderas inte även om blodglukosen ligger utanför målvärdet. Under denna tidsperiod har inte den tidigare dosen nått sin högsta verkan och ytterligare korrigeringsdoser, vilket kallas för "insulinansamling", kan leda till hypoglykemi.
- Insulindoser som beräknas 2–4 timmar efter en tidigare loggad dos kommer att ha aktivt insulin borträknat från den föreslagna dosen.
- Allt tidigare injicerat direktverkande insulin ska loggas för att säkerställa korrekt spårning och beräkning av aktivt insulin.

Kalkylatorinställningar – alternativet Enkel

Denna sida kan användas för att skriva ned inställningarna för insulinkalkylatorn.

Frukostdos

enheter insulin

0–50

Lunchdos

enheter insulin

0–50

Middagsdos

enheter insulin

0–50

► Detta är insulinet som krävs för att täcka mat.

Korrigeringsmålvärde

 –

mmol/L mmol/L

3,9–10,0 3,9–10,0

► Detta är det önskade området för blodglukos före måltid.

Korrigeringsfaktor
1E insulin för

mmol/L

0,1–5,5 (eller Ingen korrigeringsfaktor)

► Detta är den uppskattade mängd blodglukos kommer att sjunka om patienten tar en enhet insulin.

Ändringar av dessa inställningar kan endast göras av sjukvårdspersonal.

Avancerad inställning av insulinkalkylatorn

Steg

Åtgärd

1

Välj inställningsalternativ

Avancerad

För patienter som räknar kolhydrater (i gram eller per portion) för att justera sin dos av direktverkande insulin vid måltider.

Tillbaka Nästa

Välj alternativet **Avancerad** med reglaget och tryck på **nästa**.

Obs! Du behöver veta din patients insulininställningar för måltid, målglukosområde, korrigeringsfaktor och insulinduration.

2

Ange kost i: ?

Gram kolhydr.

Portioner

Tillbaka Nästa

Tryck för att välja hur måltids-/kolhydratinformation ska anges. Tryck på **nästa**.

Gå till Steg 3 för **Gram kolhydr.**

Gå till Steg 4 för **Portioner**.

Steg

Åtgärd

3

Om du väljer att ange gram kolhydr. i Steg 2: Föreslagen dos av direktverkande insulin baserat på gram kolhydr.

Ange **Kolhydratkvot** (1E direktverkande insulin för _____ gram kolhydr.). Tryck på **nästa** när du är klar.

Obs! Om du vill ställa in olika portionskvoter för olika tider på dygnet, tryck på alternativet **Vid tid på dygnet**. Tryck på varje tidsperiod för att ändra kolhydratkvoten. Tryck på **OK** efter varje post för att spara. Tryck på **klar**.

gå till Steg 5.

Tidsblock på dygnet kan inte justeras. De motsvarar följande tider:

Morgon	4.00–9.59
Mitt på dagen	10.00–15.59
Kväll	16.00–21.59
Natt	22.00–3.59

Steg

Åtgärd

4

Portionsdefinition ?

1 portion =
10,0
gram kolhydr.

+
-

Om du väljer att ange portioner i **Steg 2**: Den föreslagna dosen direktverkande insulin baseras på portioner.

tillbaka

Portionskvot ?

För 1 portion:
1,5
enheter insulin

Valfri: vid tid på dygnet

tillbaka nästa

Ange **Portionsdefinition** (10 till 15 gram kolhydr.) och tryck på **nästa**. Ange **Portionskvot** (___ enheter direktverkande insulin per 1 portion kolhydr.). Tryck på **nästa** när du är klar.

Portionskvot för 1 portion:

2 E ins morgon

3 E ins natt

3 E ins lunchtid

4 E ins kväll

tillbaka

Obs! Om du vill ställa in olika kolhydratkvoter för olika tider på dygnet, tryck på alternativet **Vid tid på dygnet**. Tryck på varje tidsperiod för att ändra portionskvoten. Tryck på **OK** efter varje post för att spara. Tryck på **klar**.

tillbaka

Portionskvot OK

För 1 portion:
2
enheter insulin

Morgon:
4.00 till 10.00

Steg

Åtgärd

5

Hur korrigerar din patient sitt glukos? ?

Till ett enskilt målvärde

Till ett målområde

tillbaka nästa

Välj hur du vill att din patient ska korrigera sitt glukosvärde. Tryck på **nästa**.

6

Korrigeringsmålvärde ?

▲

▼

5,6 mmol/L

Valfri: vid tid på dygnet

tillbaka

Korrigeringsmålvärde i mmol/L ?

5,6 morgon

6,7 natt

6,1 lunchtid

5,6 kväll

tillbaka

Korrigeringsmålvärde OK

▲

▼

5,6 mmol/L

Morgon:
4.00 till 10.00

Ange **Korrigeringsmålvärde** eller -område. Detta är det önskade målvärdet eller -området för blodglukosvärdet före måltider. Tryck på **nästa** när du är klar.

Obs! Om korrigeringsmålvärdet baseras på tid på dygnet, tryck på alternativet **Vid tid på dygnet**. Tryck på varje tidsperiod för att ändra korrigeringsmålvärdet för respektive period. Tryck på **OK** efter varje post för att spara. Tryck på **klar**.

Steg

Åtgärd

7

Korrigeringsfaktor ?

1 E insulin för
0,6 mmol/L

Valfr: vid tid på dygnet

Korrigeringsfaktor ?
1 E insulin för:

1,7 mmol/L morgon

1,1 mmol/L natt

1,1 mmol/L lunchtid

0,8 mmol/L kväll

tillbaka

Korrigeringsfaktor OK

1 E insulin för
0,6 mmol/L


Morgon:
4.00 till 10.00

Ange **Korrigeringsfaktor** (exempel: om 1E insulin sänker blodglukosvärdet med 2,8 mmol/L blir korrigeringsfaktorn 2,8). Om blodglukosen ligger utanför blodglukosmålet använder kalkylatorn korrigeringsmålvärdet och -faktorn för att beräkna en korrigeringsdos. Tryck på **nästa** när du är klar.

Anmärkningar:

- Om korrigeringsfaktorn baseras på tid på dygnet, tryck på alternativet **Vid tid på dygnet**. Tryck på varje tidsperiod för att ändra korrigeringsfaktorn för respektive period. Tryck på **OK** efter varje post för att spara. Tryck på **klar**.
- Kalkylatorn korrigerar ett blodglukosvärde till ett enstaka mål eller medelvärde av målområdet.
- Kalkylatorn föreslår inte en dos som uppskattas få blodglukosvärdet att sjunka under den lägre delen av målområdet eller enstaka mål.

8



Ange **Insulinduration**. Detta är den tid som det direktverkande insulinet förblir aktivt i patientens kropp.

Tryck på **nästa**.

VIKTIGT! I allmänhet sträcker sig insulinduration för direktverkande insulin mellan 3–5 timmar. Detta kan variera från person till person¹. Avläsaren tillåter en insulinduration mellan 3–8 timmar.

¹ Bipacksedlar: HumaLog®, NovoLog®, Apidra®

Steg

Åtgärd


9

Vill du att symbolen för aktivt insulin visas på hemskrämen? ?

Ja

Nej

tillbaka nästa

Välj om symbolen **Aktivt insulin**  ska visas på hemskrämen.

Symbolen visar en uppskattning av mängden direktverkande insulin som är kvar i kroppen och hur länge till det kan vara aktivt. Om du väljer "Nej" inkluderas fortfarande aktivt insulin i beräkningen av föreslagen dos.


Tryck på **nästa**. Tryck sedan på **klar** för att slutföra inställningen. Du kan nu granska kalkylatorinställningarna. Tryck på **OK** när du är klar.

Anteckningar om alternativet Avancerad:

- Kalkylatorn uppskattar mängden direktverkande insulin som är kvar i kroppen och hur länge till det kan vara aktivt. Uppskattningen av aktivt insulin beräknas från den inställda insulindurationen, tiden och mängden av den senast loggade dosen direktverkande insulin.
- Både måltids- och korrigeringsdoser inkluderas i spårningen av aktivt insulin.
- Insulindoser som beräknas 0–2 timmar efter en tidigare loggad dos inkluderar endast en måltidsdos. Aktivt insulin räknas inte bort från måltids- eller kolhydratdosen, och en korrigeringsdos inkluderas inte även om blodglukosvärdet ligger utanför målvärdet. Under denna tidsperiod har inte den tidigare dosen nått sin högsta verkan och ytterligare korrigeringsdoser, vilket kallas för "insulinansamling", kan resultera i hypoglykemi.
- Insulindoser som beräknats mellan två timmar och inställd insulinduration kommer att räkna bort aktivt insulin från den föreslagna dosen (om till exempel insulinduration är inställd på fem timmar dras aktivt insulin bort från doser beräknade mellan 2–5 timmar).
- Allt tidigare injicerat direktverkande insulin ska loggas för att säkerställa korrekt spårning och beräkning av aktivt insulin.

Detta diagram visar hur insulinkalkylatorn uppskattar mängden aktivt insulin som en funktion av loggad insulindos och insulinduration över tid. Det visar även relationen mellan symbolen 🍪 och mängden aktivt insulin.

Aktivt insulin kurvlinjär modell

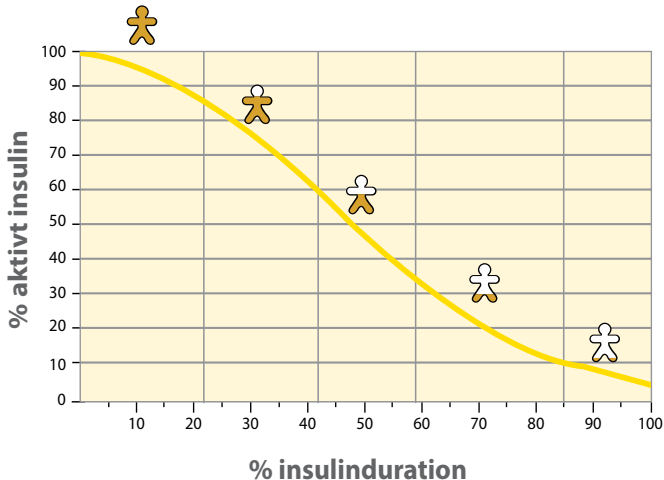

Anpassad efter Mudaliar et al. Diabetes Care, Volume 22(9), Sept 1999, pp 1501-1506

Kalkylatorinställningar – alternativet Avancerad

Denna sida kan användas för att skriva ned inställningarna för insulinkalkylatorn.

Kolhydratkvot
1 enhet insulin för

gram kolhydrater

ELLER 1-50

► Detta är antalet gram kolhydr. som en enhet direktverkande insulin kommer att täcka ELLER antalet enheter direktverkande insulin som täcker en portion. (Alternativ att ange Vid tid på dygnet.)

Portions-
definition

gram kolhydrater

10-15

Portionskvot
För 1 portion tas

enheter insulin

0,5-15

Korrigerings-
småvärde

mmol/L

3,9-10,0

ELLER

► Detta är det önskade målvärdet eller -området för blodglukos före måltid. (Alternativ att ange Vid tid på dygnet.)

Område för
korrigeringsmålvärde

 till

mmol/L mmol/L

3,9-10,0 3,9-10,0

Korrigeringsfaktor
1 enhet insulin för

mmol/L

0,1-5,5

- ▶ Detta är den uppskattade mängd blodglukos kommer att sjunka om patienten tar en enhet insulin. (Alternativ att ange Vid tid på dygnet.)

Insulinduration
Insulin är aktivt i kroppen i

timmar:minuter

3-8

- ▶ Detta är den tid som en dos direktverkande insulin förblir aktivt i kroppen.




Funktionen Aktivt
insulin?

Ja

Nej

Ändringar av dessa inställningar kan endast göras av sjukvårdspersonal.

Ändra inställningarna för insulinkalkylatorn

Steg	Åtgärd
<p>1</p>	 <p>Tryck på inställningssymbolen  på hemskrämen. Rulla ned med pilarna och tryck på Sjukvårdsalternativ Skriv in åtkomstkoden. Tryck på Insulinkalkylator.</p>
<p>2</p>	 <p>Tryck på Stäng av kalkylator för att stänga av insulinkalkylatorn eller på Ändra kalkylatorinställningar för att ändra inställningarna för insulinkalkylatorn.</p> <p>Obs! Om du stänger av insulinkalkylatorn kommer din patient inte längre att se kalkylatorknappen efter ett blodglukostest. Du kan slå på kalkylatorn igen genom att göra om inställningen av insulinkalkylatorn.</p>

Systemets specifikationer

Se teststickans och kontrolllösningens bruksanvisningar för ytterligare specifikationer.

Sensors specifikationer

Sensors analysmetod för glukos	Amperometrisk elektrokemisk sensor
Sensors avläsningsområde för glukos	2,2 till 27,8 mmol/L
Sensors storlek	5 mm hög och 35 mm i diameter
Sensors vikt	5 gram
Sensors strömkälla	Ett silveroxidbatteri
Sensors livslängd	Upp till 14 dagar
Sensors minne	8 timmar (glukosvärden lagras var 15:e minut)

Sensorns överföringsområde	6 meter (20 fot) utan hinder
Driftstemperatur	10 °C till 45 °C
Förvaringstemperatur för sensorapplikator och sensorförpackning	4 °C till 25 °C
Relativ fuktighet vid drift och förvaring	10 % till 90 %, icke kondenserande
Sensorns vattentäthet och skydd mot intrång av vätska	IP27: Klarar av att sänkas ned en meter (tre fot) i vatten i upp till 30 minuter. Den är även skyddad mot införande av föremål > 12 mm diameter
Drifts- och förvaringsaltitud	-381 meter (-1 250 fot) till 3 048 meter (10 000 fot)
Radiofrekvens	2,402–2,480 GHz BLE; GFSK; 0 dBm EIRP

Avläsarens specifikationer




















Mätområde för blodglukos	1,1 till 27,8 mmol/L
Mätområde för blodketon	0,0 till 8,0 mmol/L
Avläsarens storlek	95 mm x 60 mm x 16 mm
Avläsarens vikt	65 gram
Avläsarens strömkälla	Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri
Avläsarens batterilivslängd	Fyra dagars normal användning
Avläsarens minne	90 dagar normal användning
Avläsarens driftstemperatur	10 °C till 45 °C
Avläsarens förvaringstemperatur	-20 °C till 60 °C
Relativ fuktighet vid drift och förvaring	10 % till 90 %, icke kondenserande

Avläsarens fuktskydd	Förvaras torrt
Drifts- och förvaringsaltitud	-381 meter (-1 250 fot) till 3 048 meter (10 000 fot)
Tidsgräns för avläsarens teckenfönster	60 sekunder (120 sekunder när teststikan är införd)
Radiofrekvens	13,56 MHz RFID; Amplitudskiftmodulering; 124 dBuV/m 2,402–2,480 GHz BLE; GFSK; 2 dBm EIRP
Dataport	Mikro-USB
Minimikrav dator	Systemet får endast användas med EN60950-1-klassade datorer
Medelbrukslängd	Tre år normal användning
Strömadapter	Abbott Diabetes Care PRT25613 Driftstemperatur: 10 °C till 40 °C
USB-kabel	Abbott Diabetes Care PRT21373 Längd: 94 cm (37 tum)

Specifikationer för kalkylatorn för direktverkande insulin

Parameter	Enhet	Område eller värde
Korrigeringsmålvärde	mmol/L	3,9 till 10,0
Kolhydratkvot	1E per x gram kolhydr.	1 till 50
Portionskvot	Enheter insulin per portion	0,5 till 15
Portionsdefinition	Gram kolhydr.	10 till 15
Insulindoser måltid (frukost, lunch, middag)	Enheter insulin	0 till 50
Korrigeringsfaktor	1E per x mmol/L	0,1 till 5,5
Insulinduration (duration på insulinåtgärd)	Timmar	Enkel: 4 Avancerad: 3 till 8
Dossteg	Enheter insulin	0,5 eller 1
Högsta insulindos	Enheter insulin	50

Symboler på märkningen

	Se bruksanvisningen		Sista förbrukningsdatum
	Temperaturgräns		Katalognummer
	Tillverkare		Tillverkningsdatum
	CE-märkning		Serienummer
	Auktoriserad representant i Europeiska gemenskaperna		Enkelt sterilt barriärsystem
	Batchkod		Förvaras torrt
	Typ BF patientansluten del		Icke joniserande strålning
	Sensorkod		Försiktig
	Får inte återanvändas		Fuktighetsgränser
	Steriliserad med strålning		



Steril barriär. Se Bruksanvisningen om den är öppen eller skadad.



Får inte användas om förpackningen är skadad.
För steril barriär: Använd inte om produktens sterila barriärsystem eller dess förpackning har brutits eller skadats.



Denna produkt får inte kasseras via kommunal (hushålls) avfallshantering. Kräver separat insamling för elektriskt och elektroniskt avfall enligt direktiv 2012/19/EG inom Europeiska unionen. Kontakta tillverkaren för mer information.

Elektromagnetisk kompatibilitet

- Systemet kräver särskilda försiktighetsåtgärder gällande elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och måste installeras och tas i bruk enligt den information om EMC som anges i denna handbok.
- Bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning kan påverka systemet.
- Användning av andra tillbehör, givare och kablar än de som anges av Abbott Diabetes Care kan leda till ökade EMISSIONER eller minskad IMMUNITET för systemet.
- Systemet bör inte användas intill eller placerad i stapel tillsammans med annan utrustning och om den måste användas intill eller i stapel med annan utrustning ska du kontrollera att systemet fungerar normalt i den konfiguration som den kommer att användas i.

Vägledning och tillverkarens deklARATION – elektromagnetiska emissioner

Systemet är avsett att användas i den elektromagnetiska miljö som anges nedan. Kunden eller användaren av systemet bör säkerställa att det används i sådan miljö.

Emissionstest	Överensstämmelse	Elektromagnetisk miljö – vägledning
RF-emissioner CISPR 11	Grupp 1	Systemet använder RF-energi endast för sin interna funktion. RF-emissionerna är därför mycket låga och det är osannolikt att de orsakar några störningar på elektronisk utrustning i närheten.
RF-emissioner CISPR 11	Klass B	Systemet är lämplig för användning i alla miljöer, inklusive i bostäder och byggnader som är direktanslutna till det allmänna lågspänningsnät som förser byggnader som används som bostäder med spänning.
Övertonsemissioner IEC 61000-3-2	Klass A	
Spänningsfluktuationer/ flimmeremissioner IEC 61000-3-3	Överensstämmer	

Vägledning och tillverkarens deklARATION – elektromagnetisk immunitet

Systemet är avsett att användas i den elektromagnetiska miljö som anges nedan. Kunden eller användaren av systemet bör säkerställa att det används i sådan miljö.

IMMUNITET test	IEC 60601 testnivå	Överensstäm- menivå	Elektromagnetisk miljö – vägledning
Elektrostatisk urladdning (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV kontakt ± 15 kV luft	± 8 kV kontakt ± 15 kV luft	Golv ska vara tillverkade av trä, betong eller keramikplattor. Om golven är täckta med syntetmaterial bör den relativa luftfuktigheten vara minst 30 %.
Elektriska snabba transienter/skurar IEC 61000-4-4	± 2 kV för ledningar för spännings-tillförsel ± 1 kV för in-/utgående ledningar	± 2 kV för ledningar för spännings-tillförsel ± 1 kV för in-/utgående ledningar	Spänningsförsörjningen via elnätet ska vara av sådan kvalitet som normalt råder i bostads-, kommersiell eller sjukhusmiljö.

IMMUNITET test	IEC 60601 testnivå	Överensstämme- senivå	Elektromagnetisk miljö – vägledning
Stötpulser IEC 61000-4-5	± 1 kV differentialläge läge ± 2 kV normalläge	± 1 kV differentialläge läge ± 2 kV normalläge	Spänningsförsörjningen via elnätet ska vara av sådan kvalitet som normalt råder i bostads-, kommersiell eller sjukhusmiljö.
Spänningsfall, korta avbrott och spänningsvariationer på ledningar för spännings-tillförsel IEC 61000-4-11	< 5 % U_T (> 95 % sänkning i U_T) i 0,5 cykel 40 % U_T (60 % sänkning i U_T) i 5 cykler 70 % U_T (30 % sänkning i U_T) i 25 cykler < 5 % U_T (> 95 % sänkning i U_T) i 5 sekunder	< 5 % U_T (> 95 % sänkning i U_T) i 0,5 cykel 40 % U_T (60 % sänkning i U_T) i 5 cykler 70 % U_T (30 % sänkning i U_T) i 25 cykler < 5 % U_T (> 95 % sänkning i U_T) i 5 sekunder	Spänningsförsörjningen via elnätet ska vara av sådan kvalitet som normalt råder i bostads-, kommersiell eller sjukhusmiljö. Om användaren kräver att systemet är i kontinuerlig drift under strömbavbrott rekommenderas det att systemet drivs med en avbrottsfri spänningskälla eller ett batteri.


IMMUNITET test	IEC 60601 testnivå	Överensstäm- menivå	Elektromagnetisk miljö – vägledning
Nätfrekvensens magnetfält (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Nätfrekvensens magnetfält bör ligga på en nivå som är karaktäristisk för en normal lokal i en typisk hemmiljö, kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.

OBS! U_T är nätspanningen innan testnivån appliceras.

IMMUNITET test	IEC 60601 testnivå	Överensstäm- melsenivå	Elektromagnetisk miljö – vägledning
Ledningsbunden RF IEC 61000-4-6	6 Vrms 150 kHz till 80 MHz	6 Vrms	<p>Bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning bör inte användas på närmare avstånd från någon del av systemet, inklusive kablar, än det rekommenderade separationsavstånd som beräknas med den ekvation som gäller för sändarens frekvens.</p> <p>Rekommenderat separationsavstånd</p> $d = 1,2 \sqrt{P}$
Utstrålad RF IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz till 2,7 GHz	10 V/m	<p>Rekommenderat separationsavstånd</p> $d = 1,2 \sqrt{P}$ <p>80 MHz till 800 MHz</p> $d = 2,3 \sqrt{P}$ <p>800 MHz till 2,5 GHz</p>

P är sändarens högsta uteffekt i watt (W) enligt sändarens tillverkare och d är det rekommenderade separationsavståndet i meter (m).

Fältstyrkor från fasta RF-sändare, som fastställs med en elektromagnetisk platsundersökning,^a bör vara lägre än överensstämmelsenivån inom varje frekvensintervall.^b

Störningar kan uppstå i närheten av utrustning märkt med följande symbol: 

ANMÄRKNING 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensintervallet.

ANMÄRKNING 2: Dessa riktlinjer kanske inte gäller i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av absorption och reflektion från strukturer, föremål och människor.

^a Fältstyrkor från fasta sändare, som t.ex. basstationer för radiotelefoner (mobila/trådlösa) och landmobilradio, amatörradio, AM- och FM-radiosändningar och TV-sändningar kan inte med noggrannhet förutses teoretiskt. Överväg att utföra en elektromagnetisk platsundersökning för att utvärdera hur den elektromagnetiska miljön påverkas av fasta RF-sändare. Om den uppmätta fältstyrkan på den plats där systemet används överskrider gällande överensstämmelsenivå för RF enligt ovan bör systemet observeras så att normal funktion kan verifieras. Om onormal funktion observeras kan ytterligare åtgärder krävas, som att systemet måste vridas eller förflyttas.

^b Inom frekvensintervallet 150 kHz till 80 MHz ska fältstyrkorna vara lägre än 10 V/m.

Rekommenderade separationsavstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning och systemet

Systemet är avsett att användas i en elektromagnetisk miljö där utstrålade RF-störningar kontrolleras. Kunden eller användaren av systemet kan hjälpa till att förebygga elektromagnetisk interferens genom att bibehålla ett minsta avstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning (sändare) och systemet enligt rekommendationerna nedan i enlighet med kommunikationsutrustningens maximala uteffekt.

Sändarens maximala uteffekt W	Separationsavstånd enligt sändarens frekvens m		
	150 kHz till 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	80 MHz till 800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	800 MHz till 2,5 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

För sändare med en maximal nominell uteffekt som inte anges ovan kan det rekommenderade separationsavståndet d i meter (m) uppskattas med den ekvation som är tillämplig för sändarens frekvens, där P är sändarens angivna högsta utgående effekt i watt (W) enligt sändarens tillverkare.

ANMÄRKNING 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller skiljeavståndet för det högre frekvensintervallet.

ANMÄRKNING 2: Dessa riktlinjer kanske inte gäller i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av absorption och reflektion från strukturer, föremål och människor.

Härmed försäkrar Abbott Diabetes Care Ltd. att denna typ av radioutrustning, FreeStyle Libre 2 avläsare, överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.diabetescare.abbott/doc.

Typsnittslicens

©2013 Abbott

Licensierad under Apache License, version 2.0 ("Licensen"). Du får inte använda denna fil förutom enligt licensen. En kopia av licensen kan erhållas på: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Om inte något annat krävs i tillämplig lag eller skriftlig överenskommelse, distribueras programvara enligt Licensen i BEFINTLIGT SKICK, UTAN GARANTIER ELLER UTFÅSTELSER AV NÅGOT SLAG, vare sig uttryckliga eller underförstådda. Se licensen för det språk som styr tillstånd och begränsningar enligt licensen.

Open source-komponenter: Material Design Icons

Upphovs rätt ©2014, Austin Andrews (<http://materialdesignicons.com/>), med ensamrätt på typsnittsnamnet Material Design Icons.

Upphovs rätt ©2014, Google (<http://www.google.com/design/>) använder licensen på <https://github.com/google/material-design-icons/blob/master/LICENSE>

Detta typsnittsprogram är licensierat under SIL Open Font License, version 1.1.

Licensen är kopierad nedan och är även tillgänglig med vanliga frågor och svar på: <http://scripts.sil.org/OFL>

SIL OPEN FONT LICENSE

Version 1.1 – 26 februari 2007

FÖRORD

Målet för Open Font License (OFL) är att stimulera världsomspännande utveckling av samverkande typsnittsprojekt, för att stödja skapande av typsnitt i akademiska och språkliga forum och för att tillhandahålla en fri och öppen struktur där typsnitt kan delas och förbättras tillsammans med andra.

OFL tillåter att licensierade typsnitt används, studeras, modifieras och omdistribueras fritt så länge de inte säljs separat. Typsnitt, inklusive eventuella härledda verk, kan paketeras, infogas, distribueras på nytt och/eller säljas med en programvara, förutsatt att inga exklusiva namn används för härledda verk. Typsnitt och härledda verka kan emellertid inte släppas under någon annan typ av licens. Kravet på att typsnitten ska förbli under denna licens gäller inte för dokument som skapats med hjälp av typsnitten eller deras derivat.

DEFINITIONER

”Typsnittsprogram” avser den uppsättning filer som släpps av upphovsrättsinnehavaren/-innehavarna under denna licens och är tydligt markerad som sådan. Detta kan inkludera källfiler, byggsript och dokumentation.

”Typsnittsnamn med ensamrätt” avser alla namn som anges som sådana enligt upphovsrättsdeklarationen/-deklarationerna.

”Originalversion” avser gruppen av typsnittsprogramkomponenter som distribueras av upphovsrättsinnehavaren/-innehavarna.

”Modifierad version” avser varje härlett verk som skapats genom att lägga till, ta bort eller ersätta – helt eller delvis – någon av komponenterna i originalversionen genom att ändra format eller genom att skicka typsnittsprogrammet till en ny miljö.

”Författare” avser alla formgivare, ingenjörer, programmerare, tekniska författare eller andra personer som bidragit till typsnittsprogrammet.

TILLSTÅND OCH VILLKOR

Tillstånd beviljas härmed kostnadsfritt till alla som erhåller en kopia av typsnittsprogrammet, att använda, studera, kopiera, sammanfoga, infoga, modifiera, distribuera på nytt och sälja modifierade och icke-modifierade kopior av typsnittsprogrammet, med förbehåll för följande villkor:

- 1) Varken typsnittsprogrammet eller någon av dess enskilda komponenter, i original eller modifierade versioner, får säljas separat.
- 2) Originalversioner eller modifierade versioner av typsnittsprogrammet kan paketeras, distribueras på nytt och/eller säljas tillsammans med en programvara, förutsatt att varje kopia innehåller ovanstående upphovsrättsinformation och denna licens. Dessa kan inkluderas antingen som fristående textfiler, läsbara rubriker eller i lämpliga maskinläsbara metadatafält inom text- eller binärfiler så länge som det är enkelt för användaren att granska dessa fält.
- 3) Ingen modifierad version av typsnittsprogrammet får använda typsnittsnamn med ensamrätt, såvida inte uttryckligt skriftligt tillstånd beviljats av respektive upphovsrättsinnehavare. Denna restriktion gäller endast det primära typsnittsnamnet som presenteras för användarna.

- 4) Namnet/namnen på upphovsrättsinnehavaren/-innehavarna eller författaren/författarna i typsnittsprogrammet får inte användas för att marknadsföra, göra reklam för eller annonsera någon modifierad version, förutom för att bekräfta bidraget/bidragen från upphovsrättsinnehavaren/-innehavarna och författaren/författarna eller med deras uttryckliga skriftliga tillstånd.
- 5) Typsnittsprogrammet, modifierat eller icke-modifierat, helt eller delvis, måste distribueras helt under denna licens och får inte distribueras under någon annan licens. Kravet på att typsnitten ska förbli under denna licens gäller inte för dokument som skapats med hjälp av typsnittsprogrammet.

UPPSÄGNING

Licensen blir ogiltig om något av ovanstående villkor inte uppfylls.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

TYPSNITTSPROGRAMMET TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL NÅGRA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE OCH INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT, PATENT, VARUMÄRKE ELLER NÅGON ANNAN RÄTTIGHET. UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER BLI ANSVARSSKYLDIGA FÖR NÅGRA ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANNAN SKYLDIGHET, INKLUSIVE ALLMÄNNA, SÄRSKILDA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA ELLER FÖLJDENLIGA SKADOR, VARE SIG GENOM EN ÅTGÄRD INOM AVTALET, SKADESTÅNDSSKYLDIGHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM UPPSTÅR GENOM ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TYPSNITTSPROGRAMMET ELLER FRÅN ANNAN HANTERING AV TYPSNITTSPROGRAMMET.

Distribuerat av:
Abbott Scandinavia AB
Abbott Diabetes Care
Hemvärnsgatan 9
171 54 Solna
Sverige
020-190 11 11

Abbott Oy
Abbott Diabetes Care
Linnoitustie 4
02600 Espoo
Suomi
0 800 555 500

Importör (EU):

Abbott GmbH
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany

The shape of the circle sensor unit, FreeStyle, Libre, and related brand marks are owned by Abbott. Other trademarks are the property of their respective owners.

Patent: <https://www.abbott.com/patents>



Abbott B.V.
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp,
The Netherlands



Abbott Diabetes Care Ltd.
Range Road
Witney, Oxon
OX29 0YL, UK

